



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0,01
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	3	Hasta:	30	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,0038	2,00	0,0058
2	7,5	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	-0,0044	2,00	0,0058
3	15	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-0,0014	2,00	0,0063
4	22,5	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,0002	2,00	0,0066
5	27	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,0009	2,00	0,0068

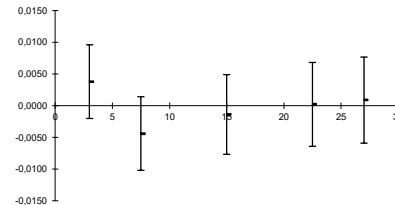

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0,01
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	7,2	Hasta:	72	Frec (Hz)	0	
Puntos	Valor IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	7,2	7,19	7,20	7,21	7,20	7,20	-0,001	2,02	0,016
2	18	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	-0,036	2,00	0,030
3	30	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	-0,045	2,00	0,043
4	54	54,11	54,11	54,11	54,11	54,11	-0,110	2,00	0,069
5	64,8	64,73	64,73	64,73	64,73	64,73	0,072	2,00	0,081

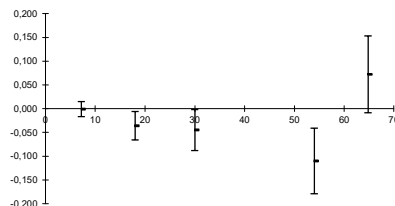

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

