


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01			
Patrón:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Frec (Hz)	0				
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	2	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	-0.0100	2.00	0.0058	0.04	Conforme	
2	5	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	-0.0100	2.00	0.0059	0.06	Conforme	
3	10	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	-0.0100	2.00	0.0059	0.10	Conforme	
4	15	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	-0.0225	2.00	0.0070	0.13	Conforme	
5	18	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	-0.0300	2.00	0.0071	0.16	Conforme	


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.05\% + \% \text{Valor medido} + 10 \text{ mV})$

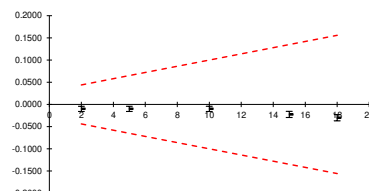

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patrón:	Transmille 4010		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.000	2.00	0.058	0.4	Conforme
2	50	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	0.112	2.00	0.058	0.7	Conforme
3	100	100.3	100.3	100.3	100.3	100.3	0.300	2.00	0.059	1.0	Conforme
4	150	150.6	150.6	150.6	150.6	150.6	0.550	2.00	0.072	1.4	Conforme
5	180	180.7	180.7	180.7	180.7	180.7	0.700	2.00	0.074	1.6	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.1\% + \text{Valor medido} + 38 \text{ mA})$

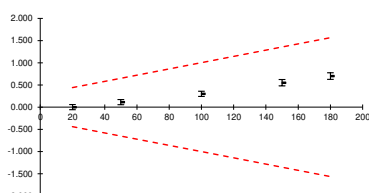

----- Tolerancia Fabricante

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

