



**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                          | Directa | Unidad: | mV     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                     | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC millivolts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                              | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 59.9                           | 59.9    | 59.9    | 59.9   | 59.9     | -0.100      | 2.00        | 0.058   |
| 2         | 150              | 149.9                          | 149.9   | 149.9   | 149.9  | 149.9    | -0.100      | 2.00        | 0.059   |
| 3         | 300              | 299.9                          | 299.9   | 299.9   | 299.9  | 299.9    | -0.100      | 2.00        | 0.061   |
| 4         | 450              | 450.0                          | 450.0   | 450.0   | 450.0  | 450.0    | 0.000       | 2.00        | 0.064   |
| 5         | 540              | 540.0                          | 540.0   | 540.0   | 540.0  | 540.0    | 0.000       | 2.00        | 0.065   |

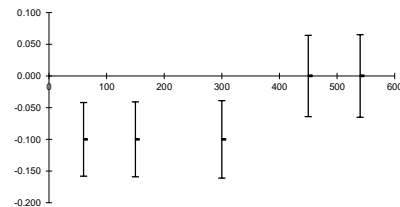


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.001   |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 0.6     | Hasta: | 6        | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 0.6              | 0.600                     | 0.600   | 0.600   | 0.600  | 0.600    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 2         | 1.5              | 1.500                     | 1.500   | 1.500   | 1.500  | 1.500    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 3         | 3                | 3.000                     | 3.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000    | 0.00000     | 2.00        | 0.00059 |
| 4         | 4.5              | 4.499                     | 4.499   | 4.499   | 4.499  | 4.499    | -0.00100    | 2.00        | 0.00071 |
| 5         | 5.4              | 5.399                     | 5.399   | 5.399   | 5.399  | 5.399    | -0.00100    | 2.00        | 0.00073 |

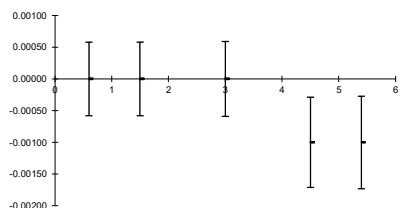

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.01    |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 6       | Hasta: | 60       | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 6                | 6.00                      | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 6.00     | -0.0010     | 2.00        | 0.0058  |
| 2         | 15               | 15.00                     | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 15.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0058  |
| 3         | 30               | 30.00                     | 30.00   | 30.00   | 30.00  | 30.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0059  |
| 4         | 45               | 45.00                     | 45.00   | 45.00   | 45.00  | 45.00    | 0.000       | 2.00        | 0.012   |
| 5         | 54               | 54.00                     | 54.00   | 54.00   | 54.00  | 54.00    | 0.000       | 2.00        | 0.012   |

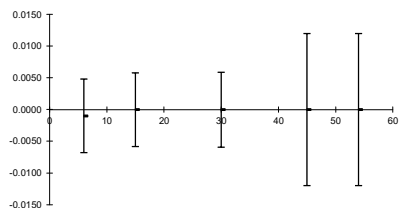

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 60.0                      | 60.0    | 60.0    | 60.0   | 60.0     | 0.000       | 2.00        | 0.059   |
| 2         | 150              | 150.0                     | 150.0   | 150.0   | 150.0  | 150.0    | 0.000       | 2.00        | 0.060   |
| 3         | 300              | 300.0                     | 300.0   | 300.0   | 300.0  | 300.0    | 0.000       | 2.00        | 0.062   |
| 4         | 450              | 449.9                     | 449.9   | 449.9   | 449.9  | 449.9    | -0.100      | 2.00        | 0.068   |
| 5         | 540              | 539.9                     | 539.9   | 539.9   | 539.9  | 539.9    | -0.100      | 2.00        | 0.070   |

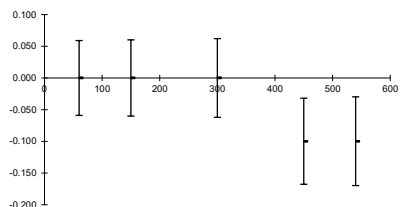

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".


(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                          | Directa | Unidad: | mV     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                     | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC millivolts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                              | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 59.9                           | 59.9    | 59.9    | 59.9   | 59.9     | -0.100      | 2.00        | 0.058   |
| 2         | 150              | 149.9                          | 149.9   | 149.9   | 149.9  | 149.9    | -0.100      | 2.00        | 0.059   |
| 3         | 300              | 299.9                          | 299.9   | 299.9   | 299.9  | 299.9    | -0.100      | 2.00        | 0.061   |
| 4         | 450              | 450.0                          | 450.0   | 450.0   | 450.0  | 450.0    | 0.000       | 2.00        | 0.064   |
| 5         | 540              | 540.0                          | 540.0   | 540.0   | 540.0  | 540.0    | 0.000       | 2.00        | 0.065   |

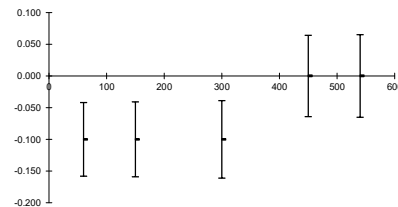


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.001   |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 0.6     | Hasta: | 6        | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 0.6              | 0.600                     | 0.600   | 0.600   | 0.600  | 0.600    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 2         | 1.5              | 1.500                     | 1.500   | 1.500   | 1.500  | 1.500    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 3         | 3                | 3.000                     | 3.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000    | 0.00000     | 2.00        | 0.00059 |
| 4         | 4.5              | 4.499                     | 4.499   | 4.499   | 4.499  | 4.499    | -0.00100    | 2.00        | 0.00071 |
| 5         | 5.4              | 5.399                     | 5.399   | 5.399   | 5.399  | 5.399    | -0.00100    | 2.00        | 0.00073 |

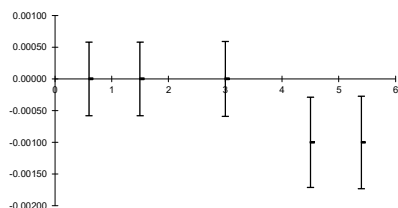

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.01    |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 6       | Hasta: | 60       | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 6                | 6.00                      | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 6.00     | -0.0010     | 2.00        | 0.0058  |
| 2         | 15               | 15.00                     | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 15.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0058  |
| 3         | 30               | 30.00                     | 30.00   | 30.00   | 30.00  | 30.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0059  |
| 4         | 45               | 45.00                     | 45.00   | 45.00   | 45.00  | 45.00    | 0.000       | 2.00        | 0.012   |
| 5         | 54               | 54.00                     | 54.00   | 54.00   | 54.00  | 54.00    | 0.000       | 2.00        | 0.012   |

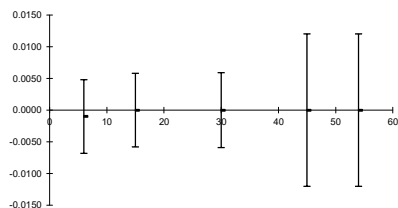

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 60.0                      | 60.0    | 60.0    | 60.0   | 60.0     | 0.000       | 2.00        | 0.059   |
| 2         | 150              | 150.0                     | 150.0   | 150.0   | 150.0  | 150.0    | 0.000       | 2.00        | 0.060   |
| 3         | 300              | 300.0                     | 300.0   | 300.0   | 300.0  | 300.0    | 0.000       | 2.00        | 0.062   |
| 4         | 450              | 449.9                     | 449.9   | 449.9   | 449.9  | 449.9    | -0.100      | 2.00        | 0.068   |
| 5         | 540              | 539.9                     | 539.9   | 539.9   | 539.9  | 539.9    | -0.100      | 2.00        | 0.070   |

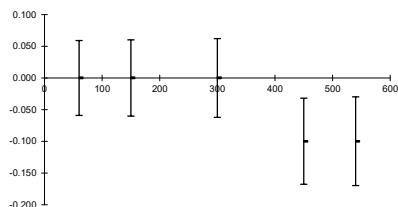

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
DIGITAL ORIGINAL  
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".


(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                          | Directa | Unidad: | mV     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                     | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC millivolts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                              | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 59.9                           | 59.9    | 59.9    | 59.9   | 59.9     | -0.100      | 2.00        | 0.058   |
| 2         | 150              | 149.9                          | 149.9   | 149.9   | 149.9  | 149.9    | -0.100      | 2.00        | 0.059   |
| 3         | 300              | 299.9                          | 299.9   | 299.9   | 299.9  | 299.9    | -0.100      | 2.00        | 0.061   |
| 4         | 450              | 450.0                          | 450.0   | 450.0   | 450.0  | 450.0    | 0.000       | 2.00        | 0.064   |
| 5         | 540              | 540.0                          | 540.0   | 540.0   | 540.0  | 540.0    | 0.000       | 2.00        | 0.065   |

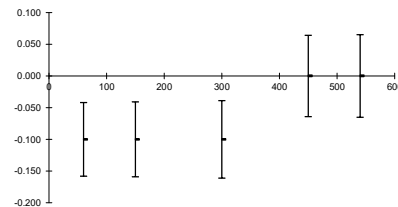


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.001   |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 0.6     | Hasta: | 6        | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 0.6              | 0.600                     | 0.600   | 0.600   | 0.600  | 0.600    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 2         | 1.5              | 1.500                     | 1.500   | 1.500   | 1.500  | 1.500    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 3         | 3                | 3.000                     | 3.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000    | 0.00000     | 2.00        | 0.00059 |
| 4         | 4.5              | 4.499                     | 4.499   | 4.499   | 4.499  | 4.499    | -0.00100    | 2.00        | 0.00071 |
| 5         | 5.4              | 5.399                     | 5.399   | 5.399   | 5.399  | 5.399    | -0.00100    | 2.00        | 0.00073 |

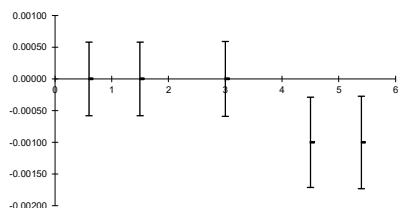

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.01    |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 6       | Hasta: | 60       | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 6                | 6.00                      | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 6.00     | -0.0010     | 2.00        | 0.0058  |
| 2         | 15               | 15.00                     | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 15.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0058  |
| 3         | 30               | 30.00                     | 30.00   | 30.00   | 30.00  | 30.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0059  |
| 4         | 45               | 45.00                     | 45.00   | 45.00   | 45.00  | 45.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |
| 5         | 54               | 54.00                     | 54.00   | 54.00   | 54.00  | 54.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |

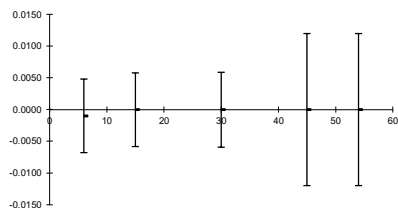

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 60.0                      | 60.0    | 60.0    | 60.0   | 60.0     | 0.000       | 2.00        | 0.059   |
| 2         | 150              | 150.0                     | 150.0   | 150.0   | 150.0  | 150.0    | 0.000       | 2.00        | 0.060   |
| 3         | 300              | 300.0                     | 300.0   | 300.0   | 300.0  | 300.0    | 0.000       | 2.00        | 0.062   |
| 4         | 450              | 449.9                     | 449.9   | 449.9   | 449.9  | 449.9    | -0.100      | 2.00        | 0.068   |
| 5         | 540              | 539.9                     | 539.9   | 539.9   | 539.9  | 539.9    | -0.100      | 2.00        | 0.070   |

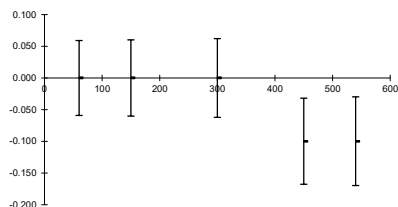

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
DIGITAL ORIGINAL  
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".


(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                          | Directa | Unidad: | mV     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                     | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC millivolts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                              | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 59.9                           | 59.9    | 59.9    | 59.9   | 59.9     | -0.100      | 2.00        | 0.058   |
| 2         | 150              | 149.9                          | 149.9   | 149.9   | 149.9  | 149.9    | -0.100      | 2.00        | 0.059   |
| 3         | 300              | 299.9                          | 299.9   | 299.9   | 299.9  | 299.9    | -0.100      | 2.00        | 0.061   |
| 4         | 450              | 450.0                          | 450.0   | 450.0   | 450.0  | 450.0    | 0.000       | 2.00        | 0.064   |
| 5         | 540              | 540.0                          | 540.0   | 540.0   | 540.0  | 540.0    | 0.000       | 2.00        | 0.065   |

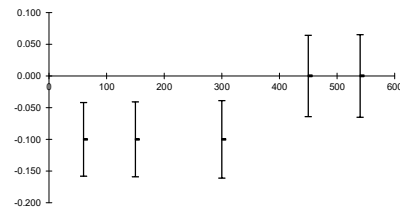


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.001   |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 0.6     | Hasta: | 6        | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 0.6              | 0.600                     | 0.600   | 0.600   | 0.600  | 0.600    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 2         | 1.5              | 1.500                     | 1.500   | 1.500   | 1.500  | 1.500    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 3         | 3                | 3.000                     | 3.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000    | 0.00000     | 2.00        | 0.00059 |
| 4         | 4.5              | 4.499                     | 4.499   | 4.499   | 4.499  | 4.499    | -0.00100    | 2.00        | 0.00071 |
| 5         | 5.4              | 5.399                     | 5.399   | 5.399   | 5.399  | 5.399    | -0.00100    | 2.00        | 0.00073 |

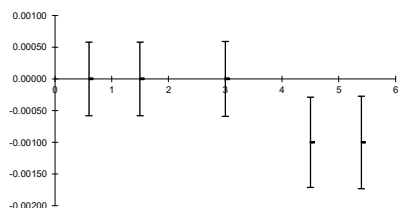

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.01    |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 6       | Hasta: | 60       | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 6                | 6.00                      | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 6.00     | -0.0010     | 2.00        | 0.0058  |
| 2         | 15               | 15.00                     | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 15.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0058  |
| 3         | 30               | 30.00                     | 30.00   | 30.00   | 30.00  | 30.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0059  |
| 4         | 45               | 45.00                     | 45.00   | 45.00   | 45.00  | 45.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |
| 5         | 54               | 54.00                     | 54.00   | 54.00   | 54.00  | 54.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |

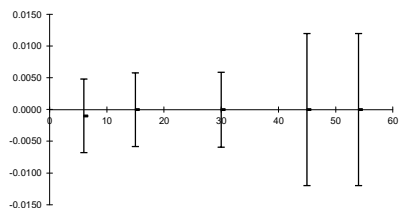

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 60.0                      | 60.0    | 60.0    | 60.0   | 60.0     | 0.000       | 2.00        | 0.059   |
| 2         | 150              | 150.0                     | 150.0   | 150.0   | 150.0  | 150.0    | 0.000       | 2.00        | 0.060   |
| 3         | 300              | 300.0                     | 300.0   | 300.0   | 300.0  | 300.0    | 0.000       | 2.00        | 0.062   |
| 4         | 450              | 449.9                     | 449.9   | 449.9   | 449.9  | 449.9    | -0.100      | 2.00        | 0.068   |
| 5         | 540              | 539.9                     | 539.9   | 539.9   | 539.9  | 539.9    | -0.100      | 2.00        | 0.070   |

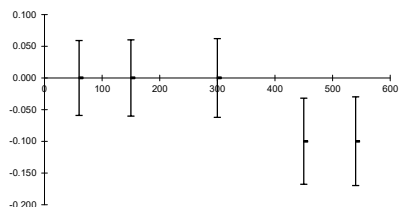

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".


(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                          | Directa | Unidad: | mV     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                     | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC millivolts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                              | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 59.9                           | 59.9    | 59.9    | 59.9   | 59.9     | -0.100      | 2.00        | 0.058   |
| 2         | 150              | 149.9                          | 149.9   | 149.9   | 149.9  | 149.9    | -0.100      | 2.00        | 0.059   |
| 3         | 300              | 299.9                          | 299.9   | 299.9   | 299.9  | 299.9    | -0.100      | 2.00        | 0.061   |
| 4         | 450              | 450.0                          | 450.0   | 450.0   | 450.0  | 450.0    | 0.000       | 2.00        | 0.064   |
| 5         | 540              | 540.0                          | 540.0   | 540.0   | 540.0  | 540.0    | 0.000       | 2.00        | 0.065   |

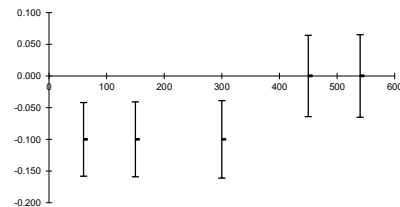


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.001   |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 0.6     | Hasta: | 6        | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 0.6              | 0.600                     | 0.600   | 0.600   | 0.600  | 0.600    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 2         | 1.5              | 1.500                     | 1.500   | 1.500   | 1.500  | 1.500    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 3         | 3                | 3.000                     | 3.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000    | 0.00000     | 2.00        | 0.00059 |
| 4         | 4.5              | 4.499                     | 4.499   | 4.499   | 4.499  | 4.499    | -0.00100    | 2.00        | 0.00071 |
| 5         | 5.4              | 5.399                     | 5.399   | 5.399   | 5.399  | 5.399    | -0.00100    | 2.00        | 0.00073 |

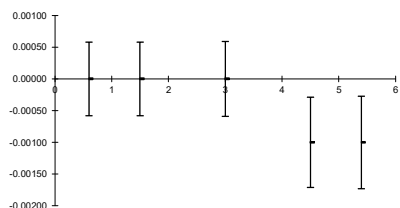

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.01    |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 6       | Hasta: | 60       | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 6                | 6.00                      | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 6.00     | -0.0010     | 2.00        | 0.0058  |
| 2         | 15               | 15.00                     | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 15.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0058  |
| 3         | 30               | 30.00                     | 30.00   | 30.00   | 30.00  | 30.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0059  |
| 4         | 45               | 45.00                     | 45.00   | 45.00   | 45.00  | 45.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |
| 5         | 54               | 54.00                     | 54.00   | 54.00   | 54.00  | 54.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |

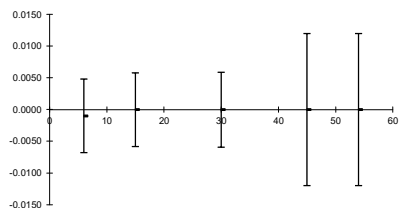

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 60.0                      | 60.0    | 60.0    | 60.0   | 60.0     | 0.000       | 2.00        | 0.059   |
| 2         | 150              | 150.0                     | 150.0   | 150.0   | 150.0  | 150.0    | 0.000       | 2.00        | 0.060   |
| 3         | 300              | 300.0                     | 300.0   | 300.0   | 300.0  | 300.0    | 0.000       | 2.00        | 0.062   |
| 4         | 450              | 449.9                     | 449.9   | 449.9   | 449.9  | 449.9    | -0.100      | 2.00        | 0.068   |
| 5         | 540              | 539.9                     | 539.9   | 539.9   | 539.9  | 539.9    | -0.100      | 2.00        | 0.070   |

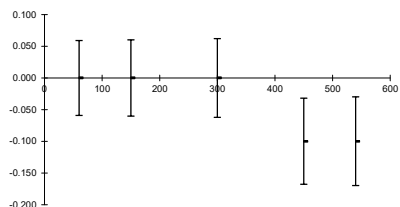

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".


(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                          | Directa | Unidad: | mV    | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                     | Desde:  | Hasta:  | 60    | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC millivolts |         |         |       |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                              | 2       | 3       | 4     | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 59.9                           | 59.9    | 59.9    | 59.9  | 59.9     | -0.100      | 2.00        | 0.058   |
| 2         | 150              | 149.9                          | 149.9   | 149.9   | 149.9 | 149.9    | -0.100      | 2.00        | 0.059   |
| 3         | 300              | 299.9                          | 299.9   | 299.9   | 299.9 | 299.9    | -0.100      | 2.00        | 0.061   |
| 4         | 450              | 450.0                          | 450.0   | 450.0   | 450.0 | 450.0    | 0.000       | 2.00        | 0.064   |
| 5         | 540              | 540.0                          | 540.0   | 540.0   | 540.0 | 540.0    | 0.000       | 2.00        | 0.065   |

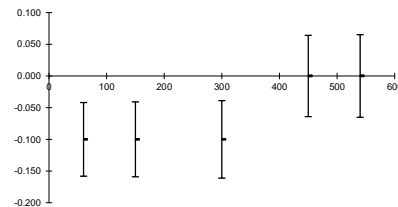


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.001   |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | Hasta:  | 0.6   | 6        | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |       |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4     | 5        |             |             |         |
| 1         | 0.6              | 0.600                     | 0.600   | 0.600   | 0.600 | 0.600    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 2         | 1.5              | 1.500                     | 1.500   | 1.500   | 1.500 | 1.500    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 3         | 3                | 3.000                     | 3.000   | 3.000   | 3.000 | 3.000    | 0.00000     | 2.00        | 0.00059 |
| 4         | 4.5              | 4.499                     | 4.499   | 4.499   | 4.499 | 4.499    | -0.00100    | 2.00        | 0.00071 |
| 5         | 5.4              | 5.399                     | 5.399   | 5.399   | 5.399 | 5.399    | -0.00100    | 2.00        | 0.00073 |

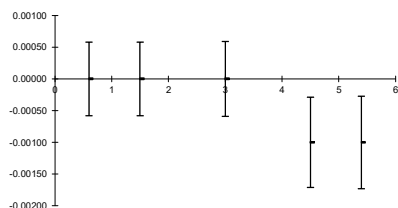

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.01    |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | Hasta:  | 6     | 60       | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |       |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4     | 5        |             |             |         |
| 1         | 6                | 6.00                      | 6.00    | 6.00    | 6.00  | 6.00     | -0.0010     | 2.00        | 0.0058  |
| 2         | 15               | 15.00                     | 15.00   | 15.00   | 15.00 | 15.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0058  |
| 3         | 30               | 30.00                     | 30.00   | 30.00   | 30.00 | 30.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0059  |
| 4         | 45               | 45.00                     | 45.00   | 45.00   | 45.00 | 45.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |
| 5         | 54               | 54.00                     | 54.00   | 54.00   | 54.00 | 54.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |

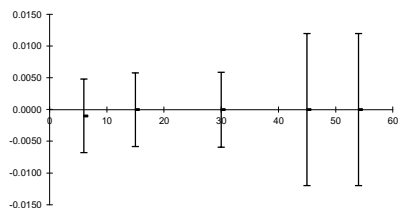

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | Hasta:  | 60    | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |       |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4     | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 60.0                      | 60.0    | 60.0    | 60.0  | 60.0     | 0.000       | 2.00        | 0.059   |
| 2         | 150              | 150.0                     | 150.0   | 150.0   | 150.0 | 150.0    | 0.000       | 2.00        | 0.060   |
| 3         | 300              | 300.0                     | 300.0   | 300.0   | 300.0 | 300.0    | 0.000       | 2.00        | 0.062   |
| 4         | 450              | 449.9                     | 449.9   | 449.9   | 449.9 | 449.9    | -0.100      | 2.00        | 0.068   |
| 5         | 540              | 539.9                     | 539.9   | 539.9   | 539.9 | 539.9    | -0.100      | 2.00        | 0.070   |

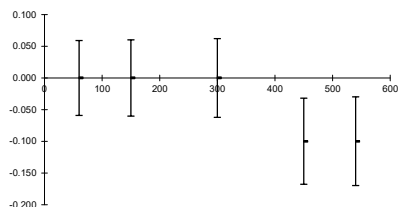

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".


(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                          | Directa | Unidad: | mV     | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                     | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC millivolts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                              | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 59.9                           | 59.9    | 59.9    | 59.9   | 59.9     | -0.100      | 2.00        | 0.058   |
| 2         | 150              | 149.9                          | 149.9   | 149.9   | 149.9  | 149.9    | -0.100      | 2.00        | 0.059   |
| 3         | 300              | 299.9                          | 299.9   | 299.9   | 299.9  | 299.9    | -0.100      | 2.00        | 0.061   |
| 4         | 450              | 450.0                          | 450.0   | 450.0   | 450.0  | 450.0    | 0.000       | 2.00        | 0.064   |
| 5         | 540              | 540.0                          | 540.0   | 540.0   | 540.0  | 540.0    | 0.000       | 2.00        | 0.065   |

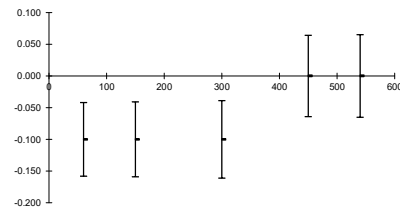


| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.001   |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 0.6     | Hasta: | 6        | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 0.6              | 0.600                     | 0.600   | 0.600   | 0.600  | 0.600    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 2         | 1.5              | 1.500                     | 1.500   | 1.500   | 1.500  | 1.500    | 0.00000     | 2.00        | 0.00058 |
| 3         | 3                | 3.000                     | 3.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000    | 0.00000     | 2.00        | 0.00059 |
| 4         | 4.5              | 4.499                     | 4.499   | 4.499   | 4.499  | 4.499    | -0.00100    | 2.00        | 0.00071 |
| 5         | 5.4              | 5.399                     | 5.399   | 5.399   | 5.399  | 5.399    | -0.00100    | 2.00        | 0.00073 |

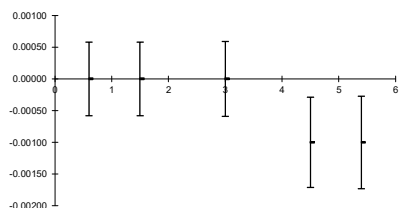

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.01    |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 6       | Hasta: | 60       | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 6                | 6.00                      | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 6.00     | -0.0010     | 2.00        | 0.0058  |
| 2         | 15               | 15.00                     | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 15.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0058  |
| 3         | 30               | 30.00                     | 30.00   | 30.00   | 30.00  | 30.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.0059  |
| 4         | 45               | 45.00                     | 45.00   | 45.00   | 45.00  | 45.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |
| 5         | 54               | 54.00                     | 54.00   | 54.00   | 54.00  | 54.00    | 0.0000      | 2.00        | 0.012   |

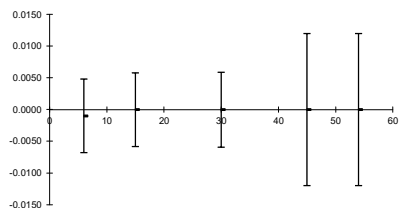

| Magnitud: | Tensión          | Tipo:                     | Directa | Unidad: | V      | Medición | IN          | Resol. IBC: | 0.1     |
|-----------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| Patron:   | Fluke 5522A      | Intervalo:                | Desde:  | 60      | Hasta: | 600      | Frec ( Hz ) | 0           |         |
| Punto     | Valor del Patrón | Lecturas del IBC DC Volts |         |         |        |          | Error       | k (95%)     | U (95%) |
|           |                  | 1                         | 2       | 3       | 4      | 5        |             |             |         |
| 1         | 60               | 60.0                      | 60.0    | 60.0    | 60.0   | 60.0     | 0.000       | 2.00        | 0.059   |
| 2         | 150              | 150.0                     | 150.0   | 150.0   | 150.0  | 150.0    | 0.000       | 2.00        | 0.060   |
| 3         | 300              | 300.0                     | 300.0   | 300.0   | 300.0  | 300.0    | 0.000       | 2.00        | 0.062   |
| 4         | 450              | 449.9                     | 449.9   | 449.9   | 449.9  | 449.9    | -0.100      | 2.00        | 0.068   |
| 5         | 540              | 539.9                     | 539.9   | 539.9   | 539.9  | 539.9    | -0.100      | 2.00        | 0.070   |

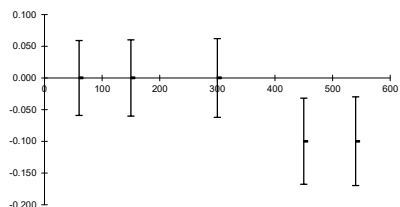

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Resultados de la calibración:**  
(Calibration Results)

**Observaciones generales**

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.  
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.  
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.  
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.  
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".  
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándose este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:  
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



**Resultados de la calibración**  
(Calibration results)

|                         | Magnitud<br><i>(Magnitude)</i>                    | Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K)<br>(Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K) |                                                 |                                                  |                                                             | Gráfica de resultado<br><i>(Grafic of result)</i> |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                         | Intervalo de medida<br><i>(Measurement range)</i> |                                                                                               | -40 °C a 400 °C<br><i>(to)</i>                  |                                                  |                                                             |                                                   |
|                         | Resolución<br><i>(Resolution)</i>                 | 0.1 °C                                                                                        |                                                 |                                                  |                                                             |                                                   |
| Punto<br><i>(Point)</i> | Valor de referencia<br><i>(Reference value)</i>   | Promedio IBC<br><i>(Average UUT)</i>                                                          | Valor de referencia<br><i>(Reference value)</i> | Sesgo instrumental<br><i>(Instrumental bias)</i> | Incertidumbre de medida<br><i>(Measurement uncertainty)</i> |                                                   |
| #                       | K                                                 | °C                                                                                            | °C                                              | °C                                               | °C                                                          |                                                   |
| 1                       | 233.15                                            | -40                                                                                           | -40.00                                          | 0.00                                             | 0.20                                                        |                                                   |
| 2                       | 433.15                                            | 160                                                                                           | 160.00                                          | 0.00                                             | 0.21                                                        |                                                   |
| 3                       | 473.15                                            | 200                                                                                           | 200.00                                          | 0.00                                             | 0.24                                                        |                                                   |
| 4                       | 573.15                                            | 300                                                                                           | 300.00                                          | 0.00                                             | 0.28                                                        |                                                   |
| 5                       | 633.15                                            | 360                                                                                           | 360.00                                          | 0.00                                             | 0.47                                                        |                                                   |

**Condiciones del instrumento:**  
(Instrument conditions)

**Requerimientos del cliente:**  
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:  
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".  
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Observaciones generales**  
(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.  
(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.  
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.  
(The results and uncertainty levels declared in this calibration certificate correspond exclusively to the instrument described in sheet 1)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.  
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de  $k=2$ , que asegura un nivel de confianza de al menos 95 % aproximadamente.  
(The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of  $k=2$ , which assures the confidence level of less than about 95 %)

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".  
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

**Descripción del método:**  
(Description of method)

- El valor actual se obtiene de un promedio de 5 mediciones realizadas para cada punto.  
(The current value is obtained from an average of 5 evaluations performed for each point)

- El sesgo instrumental se obtiene de la diferencia entre el promedio de lecturas indicado por el IBC y el valor de referencia.  
(Instrumental bias is obtained from the difference between the average readings indicated by the UUT and the reference value)

- El método de calibración es de medición directa mediante simulación eléctrica, en el cual el equipo patrón envía una señal de valor conocido en millivoltaje y que el ibc interpreta en unidades de temperatura.  
(The calibration method is direct measurement through electrical simulation, in which the standard equipment sends a signal of known value in millivoltage and that the UUT interprets in temperature units.)

- Kelvin  
(Kelvin)

- grado Celsius  
(Celsius degree)

- grado Fahrenheit  
(Fahrenheit degree)

$$^{\circ}\text{C} = \left(\frac{5}{9}\right) * (^{\circ}\text{F} - 32)$$

$$K = ^{\circ}\text{C} + 273,15$$

$$^{\circ}\text{F} = \left(\frac{9}{5}\right) * ^{\circ}\text{C} + 32$$

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:  
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
DIGITAL ORIGINAL  
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

FIN DE DOCUMENTO.