


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	3	Hasta:	30	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.0025	2.00	0.01	0.01	PASS
2	7.5	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	0.0027	2.00	0.01	0.01	PASS
3	15	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.0037	2.00	0.01	0.03	PASS
4	22.5	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	0.0037	2.00	0.01	0.04	PASS
5	27	27.01	27.01	27.01	27.01	27.01	-0.0061	2.00	0.01	0.05	PASS

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.1\% \text{ Valor medido} + 0,010 \text{ mV})$ $\pm(0.1\% \text{ Valor medido} + 0,020 \text{ mV})$

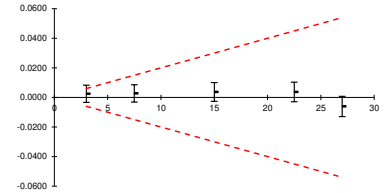

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	7.2	Hasta:	72	Frec (Hz)	0			
Puntos	Valor IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	7.2	1	2	3	4	5					
2	18	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	0.003	2.00	0.013	0.01	PASS
3	18	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	-0.010	2.00	0.030	0.04	PASS
2	30	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	0.027	2.00	0.043	0.06	PASS
4	54	53.99	53.99	53.99	53.99	53.99	0.007	2.00	0.069	0.11	PASS
5	64.8	64.78	64.78	64.78	64.78	64.78	0.016	2.00	0.081	0.13	PASS

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.1\% \text{ Valor medido} + 0,060 \text{ mV})$ $\pm(0.1\% \text{ Valor medido} + 0,070 \text{ mV})$

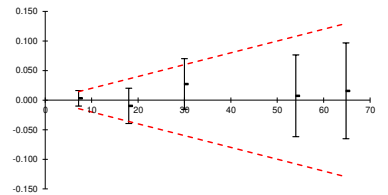

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

