


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	2	Hasta:	20	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón				Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5					
1	2	2.0003	2.0003	2.0003	2.0003	2.0003	-0.0003	2.00	0.0058	0.02	Conforme
2	5	4.9995	4.9995	4.9995	4.9995	4.9995	0.00055	2.00	0.0058	0.03	Conforme
3	10	9.9991	9.9991	9.9991	9.9991	9.9991	0.00088	2.00	0.0062	0.06	Conforme
4	15	15.0001	15.0001	15.0001	15.0001	15.0001	-1E-04	2.00	0.0063	0.09	Conforme
5	18	17.9992	17.9992	17.9992	17.9992	17.9992	0.0008	2.00	0.0065	0.10	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 20 \text{ mV})$

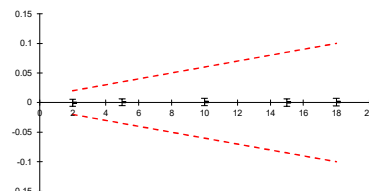

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	4.2	Hasta:	42	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patron					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	4.2	4.2056	4.2056	4.2056	4.2056	4.2056	-0.0056	2.00	0.0102	0.07	Conforme
2	10.5	10.5088	10.5088	10.5088	10.5088	10.5088	-0.0088	2.00	0.022	0.10	Conforme
3	21	20.9917	20.9917	20.9917	20.9917	20.9917	0.00831	2.00	0.033	0.15	Conforme
4	31.5	31.5025	31.5025	31.5025	31.5025	31.5025	-0.0025	2.00	0.044	0.21	Conforme
5	37.8	37.8077	37.8077	37.8077	37.8077	37.8077	-0.0077	2.00	0.051	0.24	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 84 \text{ mA})$

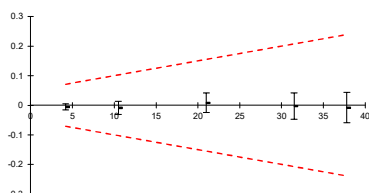

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

