


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	50	Hasta:	500	Frec (Hz)	60			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC VOLTAGE TABLE 1					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	50	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	0.000	2.00	0.059	1.5	Conforme
2	125	125.1	125.1	125.1	125.1	125.1	0.100	2.00	0.061	3.0	Conforme
3	250	250.1	250.1	250.1	250.1	250.1	0.200	2.00	0.069	5.5	Conforme
4	375	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	0.000	2.00	0.077	8.0	Conforme
5	450	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	0.000	2.00	0.082	9.5	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(2\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

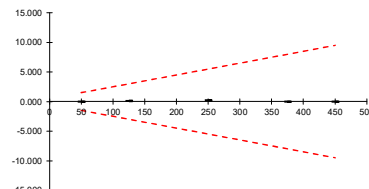


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Frec (Hz)	60			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC VOLTAGE TABLE 2					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.5	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	-0.00010	2.00	0.0016	0.012	Conforme
2	1.25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0.00030	2.00	0.0019	0.024	Conforme
3	2.5	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	0.00200	2.00	0.0023	0.043	Conforme
4	3.75	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0.00010	2.00	0.017	0.061	Conforme
5	4.5	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0.00000	2.00	0.017	0.073	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

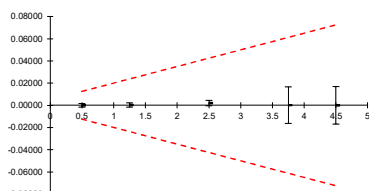


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	50	Frec (Hz)	60			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC VOLTAGE TABLE 3					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-0.0010	2.00	0.060	0.12	Conforme
2	12.5	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	0.0300	2.00	0.061	0.24	Conforme
3	25	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03	0.0300	2.00	0.063	0.43	Conforme
4	37.5	37.52	37.52	37.52	37.52	37.52	0.0200	2.00	0.15	0.61	Conforme
5	45	45.02	45.02	45.02	45.02	45.02	0.0200	2.00	0.16	0.73	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

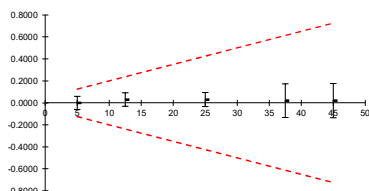

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	50	Frec (Hz)	60			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC VOLTAGE TABLE 4					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	50	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.010	2.00	0.16	1.3	Conforme
2	125	125.1	125.1	125.1	125.1	125.1	0.100	2.00	0.20	2.4	Conforme
3	250	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	0.000	2.00	0.26	4.3	Conforme
4	375	374.9	374.9	374.9	374.9	374.9	-0.100	2.00	0.39	6.1	Conforme
5	450	449.9	449.9	449.9	449.9	449.9	-0.100	2.00	0.45	7.2	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

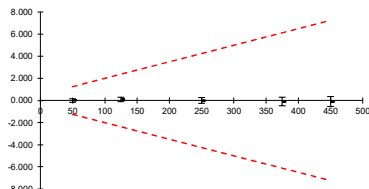

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	100	Hasta:	1000	Frec (Hz)	60			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC VOLTAGE TABLE 5					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	100	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	0.10	2.0	0.059	2.0	Conforme
2	250	250.1	250.1	250.1	250.1	250.1	0.10	2.0	0.061	4.3	Conforme
3	500	499.8	499.8	499.8	499.8	499.8	-0.20	2.0	0.069	8.0	Conforme
4	750	750.0	750.0	750.0	750.0	750.0	0.00	2.0	0.077	11.8	Conforme
5	900	899.0	899.0	899.0	899.0	899.0	-1.00	2.0	0.082	14.0	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

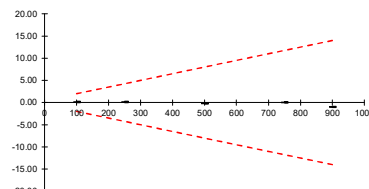

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.5	Hasta:	5	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC DC VOLTAGE TABLE 6					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.50	0.499	0.499	0.499	0.499	0.499	-0.0002	2.00	0.0012	0.0	Conforme
2	1.25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0.0001	2.00	0.0007	0.0	Conforme
3	2.50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0.0002	2.00	0.0012	0.0	Conforme
4	3.75	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0.0000	2.00	0.00070	0.0	Conforme
5	4.50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0.0000	2.00	0.00071	0.0	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ dígitos})$

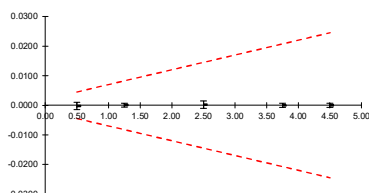

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	50	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC DC VOLTAGE TABLE 7						k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	5	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	0.00100	2.00	0.0058	0.05	Conforme
2	12.5	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0.00000	2.00	0.0058	0.08	Conforme
3	25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.00000	2.00	0.0059	0.15	Conforme
4	37.5	37.510	37.510	37.510	37.510	37.510	0.01000	2.00	0.012	0.21	Conforme
5	45	45.010	45.010	45.010	45.010	45.010	0.01000	2.00	0.012	0.25	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ dígitos})$

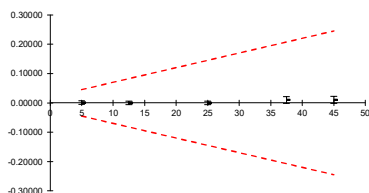

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	30	Hasta:	300	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC DC VOLTAGE TABLE 8					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	30	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.0000	2.00	0.0059	0.17	Conforme
2	75	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.0000	2.00	0.013	0.40	Conforme
3	150	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.0000	2.00	0.017	0.77	Conforme
4	225	225.10	225.10	225.10	225.10	225.10	0.1000	2.00	0.020	1.15	Conforme
5	270	270.10	270.10	270.10	270.10	270.10	0.1000	2.00	0.022	1.37	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ dígitos})$

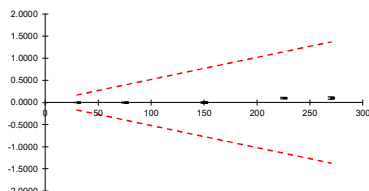

----- Tolerancia Fabricante

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	1000	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC DC VOLTAGE TABLA 9					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.000	2.00	0.013	0.7	Conforme
2	250	250.1	250.1	250.1	250.1	250.1	0.100	2.00	0.020	1.5	Conforme
3	500	500.1	500.1	500.1	500.1	500.1	0.100	2.00	0.038	2.7	Conforme
4	750	750.0	750.0	750.0	750.0	750.0	0.000	2.00	0.050	4.0	Conforme
5	900	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	0.000	2.00	0.058	4.7	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ dígitos})$

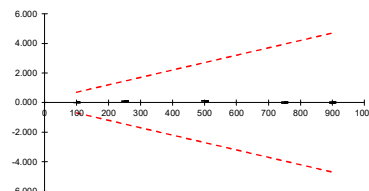

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	1000	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC DC VOLTAGE NEGATIVE TABLE 10					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	100	100	100	100	100	100	0.000	2.00	0.059	0.7	Conforme
2	250	250	250	250	250	250	0.100	2.00	0.061	1.5	Conforme
3	500	500	500	500	500	500	0.200	2.00	0.069	2.7	Conforme
4	750	750	750	750	750	750	0.000	2.00	0.077	4.0	Conforme
5	900	900	900	900	900	900	0.000	2.00	0.082	4.7	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ dígitos})$

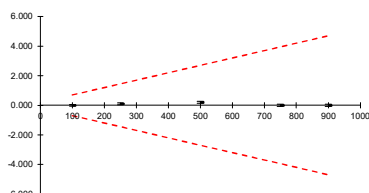

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.3	Hasta:	3	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 11					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.3	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.000	2.00	0.0058	0.0	Conforme
2	0.75	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.000	2.00	0.0058	0.0	Conforme
3	1.5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.000	2.00	0.0059	0.0	Conforme
4	2.25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0.000	2.00	0.0059	0.0	Conforme
5	2.7	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0.000	2.00	0.0059	0.0	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

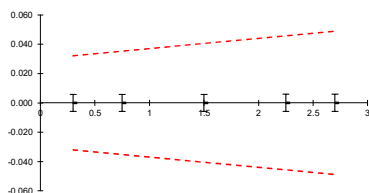

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01			
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	40	Hasta:	400	Frec (Hz)	0				
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 12					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	2.00	0.0064	0.1	Conforme	
2	13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0.000	2.00	0.0075	0.1	Conforme	
3	25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	2.00	0.026	0.2	Conforme	
4	38	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0.000	2.00	0.027	0.3	Conforme	
5	45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0.000	2.00	0.028	0.3	Conforme	

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

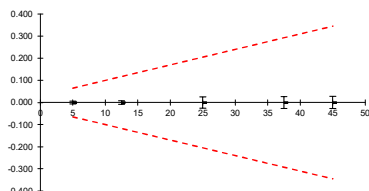

----- Tolerancia Fabricante

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	40	Hasta:	400	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 13					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	40	40.10	40.10	40.10	40.10	40.10	0.1000	2.00	0.027	0.28	Conforme
2	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.0000	2.00	0.034	0.70	Conforme
3	200	200.10	200.10	200.10	200.10	200.10	0.1000	2.00	0.06	1.40	Conforme
4	300	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	0.1000	2.00	0.20	2.10	Conforme
5	360	360.10	360.10	360.10	360.10	360.10	0.1000	2.00	0.30	2.52	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

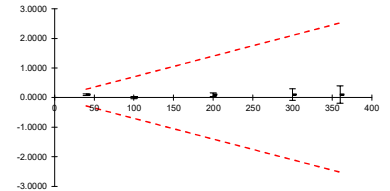

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.4	Hasta:	4	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patron	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 14					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.4	0.401	0.401	0.401	0.401	0.401	-0.001	2.00	0.0009	0.006	Conforme
2	1.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	2.00	0.0010	0.010	Conforme
3	2.0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	2.00	0.0012	0.017	Conforme
4	3.0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	2.00	0.0033	0.024	Conforme
5	3.6	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0.000	2.00	0.0034	0.028	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

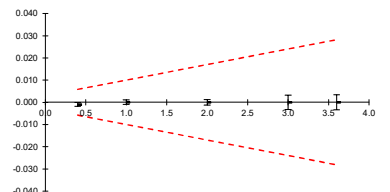

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.0001		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.9	Hasta:	9	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 15					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.90	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.00000	2.00	0.00059	0.009	Conforme
2	2.25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0.00000	2.00	0.0026	0.023	Conforme
3	4.50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0.00000	2.00	0.0075	0.045	Conforme
4	6.75	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	0.00000	2.00	0.011	0.068	Conforme
5	8.10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0.00000	2.00	0.012	0.081	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(1\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

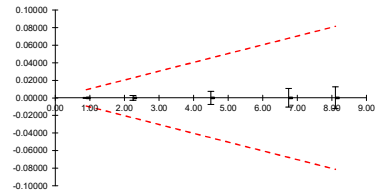

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	mA	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	50	Frec (Hz)	60			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 16					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	5.0	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	-0.0200	2.00	0.0060	0.11	Conforme
2	12.5	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	-0.0388	2.00	0.0063	0.22	Conforme
3	25.0	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03	-0.0700	2.00	0.0072	0.41	Conforme
4	37.5	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	-0.120	2.00	0.073	0.59	Conforme
5	45.0	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	-0.150	2.00	0.075	0.71	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

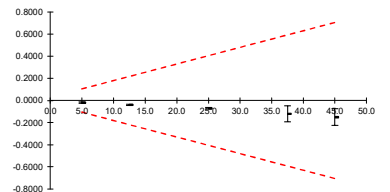

----- Tolerancia Fabricante

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	mA	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	40	Hasta:	400	Frec (Hz)	60			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 17					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	40	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	0.020	2.00	0.027	0.85	Conforme
2	100	100.2	100.2	100.2	100.2	100.2	0.200	2.00	0.035	2.05	Conforme
3	200	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	0.300	2.00	0.062	4.06	Conforme
4	300	300.3	300.3	300.3	300.3	300.3	0.300	2.00	0.20	6.06	Conforme
5	360	360.2	360.2	360.2	360.2	360.2	0.200	2.00	0.30	7.25	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(2\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

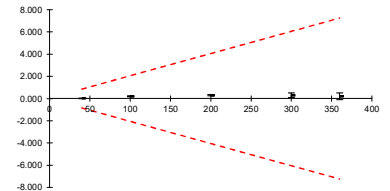

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	A	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.9	Hasta:	9	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC AC CURRENT TABLE 18					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.9	0.901	0.901	0.901	0.901	0.901	0.00100	2.00	0.0058	0.06	Conforme
2	2.25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0.05000	2.00	0.0064	0.08	Conforme
3	4.5	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	-0.00100	2.00	0.0095	0.12	Conforme
4	6.75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0.05000	2.00	0.012	0.15	Conforme
5	8.1	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0.00000	2.00	0.014	0.17	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

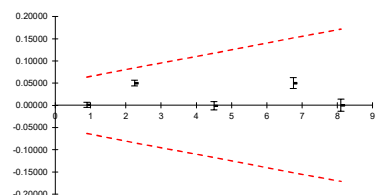

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	500	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 2 W RESISTENCE TABLE 19					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	1.9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.0100	2.00	0.0061	0.08	Conforme
2	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-0.006	2.00	0.013	0.20	Conforme
3	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.000	2.00	0.015	0.34	Conforme
4	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.012	2.00	0.017	1.55	Conforme
5	190	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.020	2.00	0.019	2.90	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

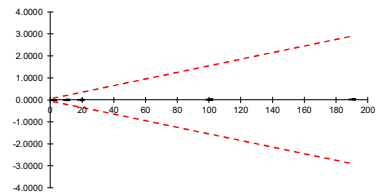

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.5	Hasta:	5	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 2 W RESISTENCE TABLE 20					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	19	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.000	2.00	0.0071	0.3	Conforme
2	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.000	2.00	0.012	1.6	Conforme
3	190	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	0.000	2.00	0.047	2.9	Conforme
4	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.000	2.00	0.0058	0.1	Conforme
5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.000	2.00	0.0058	0.1	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

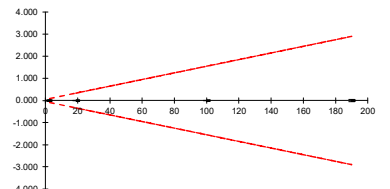

----- Tolerancia Fabricante

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	1			
Patrón:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	Hasta:	5	50	Frec (Hz)	0	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 2 W RESISTENCE TABLE 21					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	190	190	190	190	190	190	0.00	2.00	0.075	7.85	Conforme	
2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0.00	2.00	0.086	20.0	Conforme	
3	1.9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	2.00	0.00069	5.03	Conforme	
4	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2.00	0.0013	5.15	Conforme	
5	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	2.00	0.0042	5.29	Conforme	

Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ digitos})$

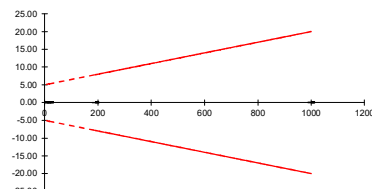


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1			
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	Hasta:	50	500	Frec (Hz)	0				
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 2 W RESISTENCE TABLE 22					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	1.9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.0000	2.00	0.00090	0.21	Conforme	
2	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.0000	2.00	0.0014	0.25	Conforme	
3	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.0000	2.00	0.0042	0.30	Conforme	
4	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.0000	2.00	0.010	0.70	Conforme	
5	190	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.0000	2.00	0.047	1.15	Conforme	

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ digitos})$

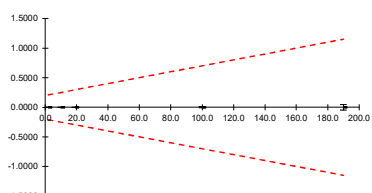


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	1			
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.5	Hasta:	5	Frec (Hz)	0	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 2 W RESISTENCE TABLE 23					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	19	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.00000	2.00	0.076	2.10	Conforme	
2	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.00000	2.00	0.273	2.50	Conforme	
3	190	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	0.00000	2.00	1.826	2.95	Conforme	
4	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.00000	2.00	0.006	2.01	Conforme	
5	1.9	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0.00000	2.00	0.006	2.01	Conforme	

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ digitos})$

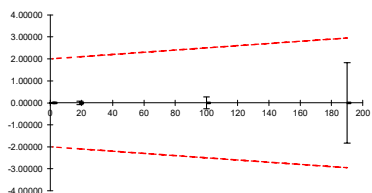

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1			
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	1.9	Hasta:	19	Frec (Hz)	0				
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 2 W RESISTENCE TABLE 24					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	190	190.10	190.10	190.10	190.10	190.10	0.0000	2.00	0.0058	1.15	Conforme	
2	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0000	2.00	0.0059	0.21	Conforme	
3	1.9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.0000	2.00	0.0059	0.21	Conforme	
4	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.0000	2.00	0.0059	0.25	Conforme	
5	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.0000	2.00	0.0059	0.30	Conforme	

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ digitos})$

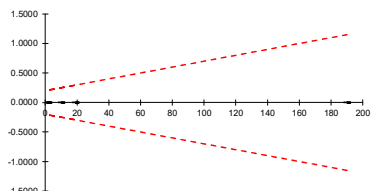

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	50	Hasta:	500	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 4 W RESISTENCE TABLE 25					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.000	2.00	0.058	0.2	Conforme
2	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.000	2.00	0.059	0.3	Conforme
3	19	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.000	2.00	0.060	0.3	Conforme
4	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.000	2.00	0.060	0.7	Conforme
5	190	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	0.000	2.00	0.060	1.2	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ digitos})$

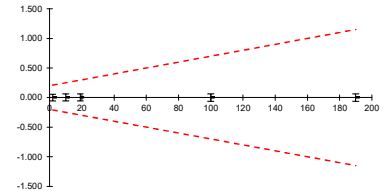

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.5	Hasta:	5	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patron	Lecturas del IBC 4 W RESISTENCE TABLE 26					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	2.00	0.0042	0.3	Conforme
2	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.00	0.010	0.7	Conforme
3	190	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2.00	0.047	1.2	Conforme
4	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00014	0.2	Conforme
5	1.9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	2.00	0.00069	0.2	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ digitos})$

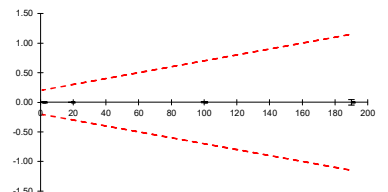

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición:	IN	Resol. IBC:	1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	5	Hasta:	50	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 4 W RESISTENCE TABLE 27					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	190	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	0.000	2.00	0.047	4	Conforme
2	1000	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	0.000	2.00	0.12	10	Conforme
3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.000	2.00	0.00090	3	Conforme
4	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.000	2.00	0.0014	3	Conforme
5	19	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.000	2.00	0.0042	3	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ digitos})$

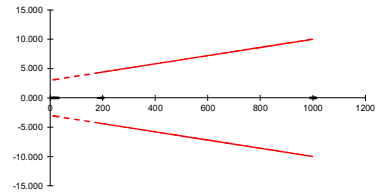

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1		
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	50	Hasta:	500	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 4 W RESISTENCE TABLE 28					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	1.9	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0.00000	2.00	0.058	0.3	Conforme
2	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00000	2.00	0.058	0.4	Conforme
3	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00000	2.00	0.058	0.4	Conforme
4	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00000	2.00	0.059	1.0	Conforme
5	190	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00000	2.00	0.074	1.6	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ digitos})$

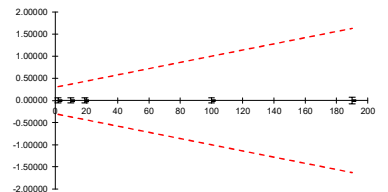

----- Tolerancia Fabricante

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1			
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	0.5	Hasta:	5	Frec (Hz)	0				
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC 4 W RESISTENCE TABLE 29					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.0000	2.00	0.076	0.4	Conforme	
2	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.0000	2.00	0.273	1.0	Conforme	
3	0.19	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.0000	2.00	0.006	0.3	Conforme	
4	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.0000	2.00	0.006	0.3	Conforme	
5	1.9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.0000	2.00	0.006	0.3	Conforme	

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ digitos})$

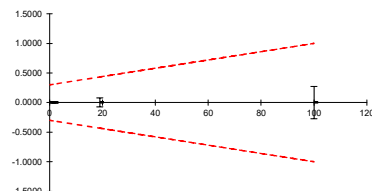

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01			
Patron:	FLUKE 5080A	Intervalo:	Desde:	1.9	Hasta:	19	Frec (Hz)	0				
Punto	Valor del Patron	Lecturas del IBC 4 W RESISTENCE TABLE 30					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.	
		1	2	3	4	5						
1	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.000	2.00	0.00058	0.0	Conforme	
2	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.000	2.00	0.00059	0.0	Conforme	
3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.000	2.00	0.0015	0.0	Conforme	
4	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.000	2.00	0.0043	0.1	Conforme	
5	19	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.000	2.00	0.076	0.2	Conforme	

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.7\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ digitos})$

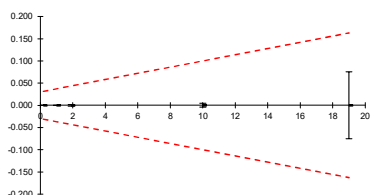

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PjLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PjLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)**Observaciones generales**

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándose este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.
- o Instrumento se encontro dentro de especificaciones de fabricante.
- o The Instrument was found within specifications Manufacturer.
- o A solicitud de cliente se indica próxima fecha de calibración a un año..

Notas:

(Notes):

A prescripción del cliente, se documenta y aplica la siguiente declaración de conformidad.

For customer requirement, the following declaration of conformity is documented and applied.

La tolerancia que el cliente emplea para este equipo, es la indicada en la especificación técnica del fabricante.

The customer tolerance required for this equipment is indicated in the manufacturer's technical specification.

La regla de decisión que el cliente pide aplicar es: $ERROR \pm U (k=2) \leq TOLERANCIA$.Customer rule of decision is: $ERROR \pm U (k=2) \leq TOLERANCIA$.

La declaración de conformidad se aplica únicamente a los datos indicados en las hojas de resultados del presente certificado.

The declaration of conformity applies only to the data indicated in the results sheets of this certificate.

En esta declaración de conformidad; el laboratorio no considera adicionalmente el nivel de riesgo, debido a que la regla es prescrita por el cliente.

In this declaration of conformity; the laboratory does not additionally consider the level of risk, because the rule is prescribed by the client.

Además que a solicitud del cliente se indica la próxima fecha de calibración

In addition, at the customer's request, the next calibration date is indicated

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

