

Resultados de la calibración
(Calibration results)

Cota	Valor nominal (Nominal value) mm	Valor mínimo (Minimal value) mm	Valor máximo (Maximum value) mm	Promedio (Average) mm	Desviación estándar (Standard deviation) mm	Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty) mm
d	0.125 0	0.131 0	0.134 0	0.132 6	0.000 7	0.003 0
W (x)	0.180 0	0.173 0	0.188 0	0.179 0	0.003 7	0.003 1
W (y)	0.180 0	0.182 0	0.194 0	0.188 2	0.003 4	0.003 1

Figura 1.
(Figure 1)

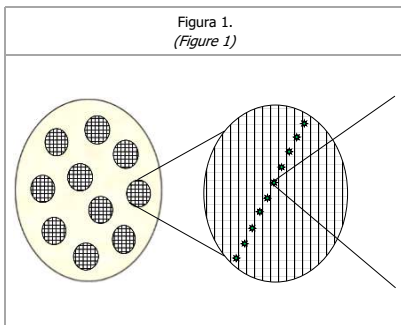


Figura 2.
(Figure 2)


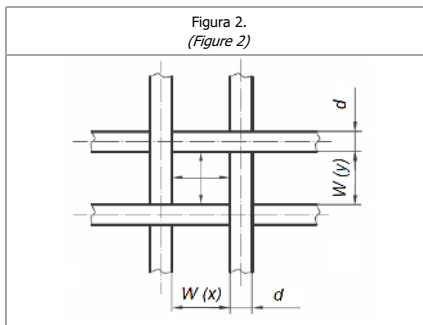


Figura 3.
(Figure 3)

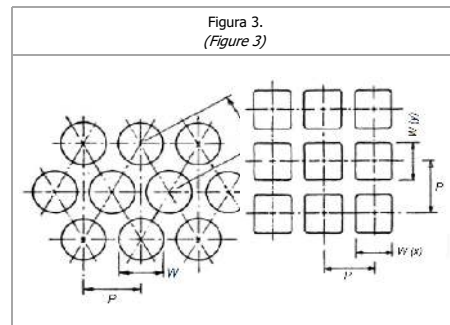

Condiciones del instrumento:

(Instrument conditions)

Sin comentarios

Requerimientos del cliente:

(Customer requirements)

A prescripción del cliente se documenta y aplica la siguiente declaración de conformidad, así como la siguiente fecha de próxima calibración.
La tolerancia que el cliente emplea y proporciona para este equipo en base al documento del cliente PROQRO-QA-024 Rev: 16, en conformidad a la norma ASTM E11.
La regla de decisión que se aplica es: $LI < \text{RESULTADO DE LA MEDICIÓN} < LS$, el equipo cumple.
La declaración de conformidad se aplica únicamente a los datos indicados en la página de resultados del presente certificado.
Los resultados obtenidos que se encuentran dentro de tolerancia, están manifestados en la página 2.
Estatus encontrado: Se encuentra en condiciones de medición.
Estatus dejado: Se deja en las mismas condiciones.
No hay resultados previos puesto que no es posible realizar ajuste y los valores reportados son la única medición necesaria para validarlo.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

