

**Resultados de la calibración**  
(Calibration results)

| Cota  | Valor nominal<br>(Nominal value) | Valor mínimo<br>(Minimal value) | Valor máximo<br>(Maximum value) | Promedio<br>(Average) | Desviación estándar<br>(Standard deviation) | Incertidumbre de medida<br>(Measurement uncertainty) |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       | mm                               | mm                              | mm                              | mm                    | mm                                          | mm                                                   |
| d     | 0.500                            | 0.503 0                         | 0.508 0                         | 0.505 6               | 0.001 3                                     | 0.003 0                                              |
| W (x) | 0.850 0                          | 0.835 0                         | 0.874 0                         | 0.856 1               | 0.007 9                                     | 0.003 2                                              |
| W (y) | 0.850 0                          | 0.832 0                         | 0.861 0                         | 0.847 8               | 0.006 7                                     | 0.003 2                                              |

Figura 1.  
(Figure 1)

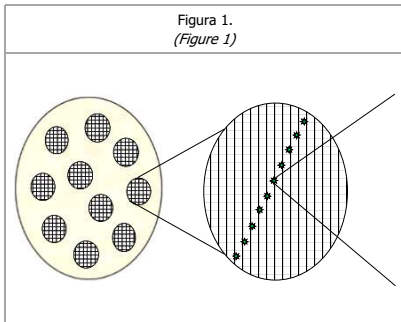


Figura 2.  
(Figure 2)


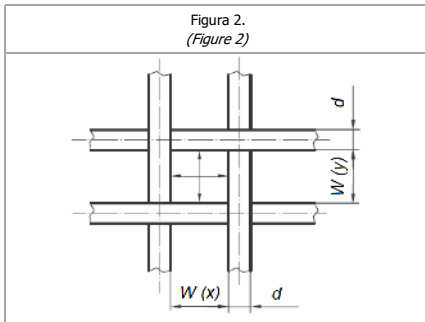


Figura 3.  
(Figure 3)

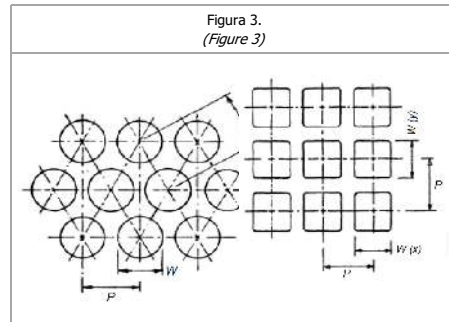

**Condiciones del instrumento:**  
(Instrument conditions)

Sin comentarios

**Requerimientos del cliente:**  
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.  
Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:  
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**DIGITAL ORIGINAL**  
**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.  
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.  
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".  
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.  
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.  
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

