

Descripción del método

Method description

El método que se emplea esta basado en la(s) norma(s): ISO 10360-2:2009 e ISO 10360-5:2020

The method used is based on standard(s): ISO 10360-2:2009 and ISO 10360-5:2020

La calibración consiste en realizar 4 pruebas:

Calibration consist of performing 4 tests:

Determinar el error de indicación en mediciones de longitud en el mismo eje del brazo. ($E_{L=0}$)

Determine the error of indication in length measurements on the same axis of the arm.

Determinar el error de indicación en mediciones de longitud a una distancia del eje del brazo. ($E_{L=150}$)

Determine the error of indication in measurements of length at a distance from the axis of the arm.

Determinar el rango de repetibilidad en mediciones de longitud. (R_0)

Determine repeatability range on length measurements.

Determinar los errores de palpado. ($P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$ Y $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$)

Determine the probing errors.

Para evaluar el error de medición de longitud se emplea:

$E_{L,MPE}$ Máximo error de medición en longitud, con $L=0$ mm, y $L=150$ mm.

Para evaluar la repetibilidad se emplea:

R_0, MPL Límite máximo permitido para el rango de repetibilidad

Declaración de la incertidumbre estimada de medición	
Statement of estimated measurement uncertainty	
U_E	
Incertidumbre de medición en longitud, con $L=0$, y $L=150$	
Expresado como ecuación de la recta:	$U_{E_L} \pm = 0.60 + 1.64 \times L \quad \mu m \quad [L] = m$

Observaciones generales

(General remarks)

Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices.

El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

The use of calibration results is the responsibility of the user.

Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales

The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

En el presente certificado el término calibración debe entenderse como verificación del desempeño según la familia de normas ISO 10360.

In this certificate the term calibration should be understood as verification of performance according to the ISO 10360 family of standards.

La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.

The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k=2$, which assures the confidence level of at least about 95%.

La incertidumbre fue estimada según la DD ISO/TS 23165:2006 que es congruente con la NMX-CH-140-IMNC-2002

The uncertainty was estimated according DD ISO/TS 23165:2006 which is consistent with NMX-CH-140-IMNC-2002

Los resultados se expresan en el Sistema Internacional de unidades (SI).

Results are expressed in the International System of Units (SI).

En los gráficos las líneas rojas se refieren a los EMP.

In charts red lines are EMP.

Los resultados de la prueba de palpado ($P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$ Y $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$) y sus incertidumbres no se encuentran en el alcance acreditado.

The results of the probing test ($P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$ Y $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$) as well as their corresponding uncertainty are not in the accredited scope.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS




Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Condiciones ambientales en las que se aplican las pruebas
Environmental conditions in which the tests are applied

Condiciones ambientales durante el proceso de calibración (Environmental conditions in which the tests are applied)

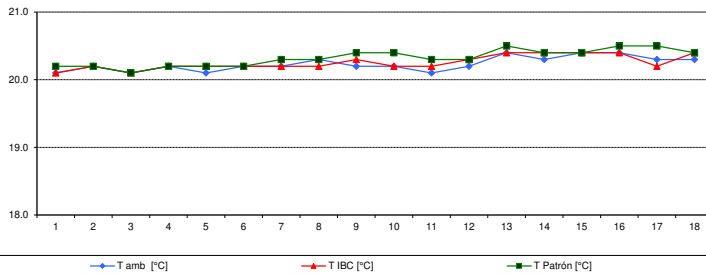

T min.	20.10	°C
T max.	20.40	°C
ΔT_{amb}	0.30	°C
Temperatura Ambiental		
20.23 °C	U = ±	0.066 °C
T min.	20.10	°C
T max.	20.40	°C
ΔT_{mmc}	0.30	°C
Temperatura de MMC		
20.26 °C	U = ±	0.066 °C

Termómetro utilizado:

Termómetro digital TESTO 720 03105567 MESS-CC-TEP-0236/2023 11/04/2025

Datos de especificaciones técnicas del equipo calibrado (Facts of specifications technical of instrument calibrated)

Modo de operación:		Automatica		Error máximo permisible de longitud	
Eje	Longitud de los ejes	Reducción de eje por sistema de palpador o accesorios		$E_{L, MPE} = \pm \frac{5 + L}{200} \mu m$	
X	2000 mm	500	mm en eje X	Error máximo permisible de repetibilidad $R_{0, MPL} = \pm 3.3 \mu m$	
Y	600 mm	100	mm en eje Y		
Z	500 mm		Sin reducción		
Resolución de las escalas		0.000 1 mm			
Tipo de cabezal para palpador:		Cabezal rotatorio indexable con dos grados de libertad			
Sistema de palpado:		Electromecánico			
Sistema intercambiador de herramientas:		Ninguno			
Temperaturas para asegurar la incertidumbre del equipo:					
T_{S_MIN} : 18 °C		ΔT_{S_1} : 1 °C/hr		ΔT_{S_H} : 1 °C/m	
T_{S_MAX} : 22 °C		ΔT_{S_24} : 2 °C/24 hr		ΔT_{S_V} : 1 °C/m	
Compensación térmica: <u>ACTIVA</u>					
CTE		X	6.5	$\times 10^{-6}$ /°C por m	Peso máximo de carga tolerado en el equipo: Kg
Efectivo para las escalas:		Y	6.5	$\times 10^{-6}$ /°C por m	1200
		Z	6.5	$\times 10^{-6}$ /°C por m	
Incertidumbre del valor CTE ($k=2$)			1	$\times 10^{-6}$ /°C por m	Las pruebas se aplican con o sin carga de trabajo
					<u>sin carga</u>
Presión nominal del aire comprimido de trabajo:		0.5 MPa			
Presión real indicada en IBC		0.5 MPa			

Pruebas de Repetibilidad
Repeatability tests

Prueba de repetibilidad del error de longitud, R_0		Mediciones en mm	
Valor máximo de repetibilidad	0.000 5	Error de repetibilidad máximo permisible $R_{0, MPL}$	0.003 3

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18. En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Error de medición de longitud E_0 para máquinas con relación de ejes largos
Length error E_0 for machines with high aspect ratio



Criterio de acuerdo a la norma para evaluar máquinas con relación de ejes largos,
(La relación del eje más largo al intermedio debe ser superior al número 3)

Relación actual de ejes:

3.3

Diagonal YZ 1, (Máquina con relación entre ejes largos)							
Longitud patrón	1 era medición	E _{L1}	2 da medición	E _{L2}	3 era medición	E _{L3}	Repetibilidad
50.001 8	50.001 4	-0.000 4	50.001 6	-0.000 2	50.001 6	-0.000 2	0.000 2
100.000 3	99.999 7	-0.000 6	99.999 7	-0.000 6	99.999 7	-0.000 6	0.000 0
199.997 9	199.996 5	-0.001 4	199.996 5	-0.001 4	199.996 6	-0.001 3	0.000 1
300.002 5	300.000 2	-0.002 3	300.000 1	-0.002 4	300.000 4	-0.002 1	0.000 3
400.002 4	399.999 6	-0.002 8	399.999 8	-0.002 6	399.999 7	-0.002 7	0.000 2
500.000 0	499.996 8	-0.003 2	499.996 9	-0.003 1	499.996 7	-0.003 3	0.000 2
Diagonal YZ 2, (Máquina con relación entre ejes largos)							
50.001 8	50.002 3	0.000 5	50.002 2	0.000 4	50.002 1	0.000 3	0.000 2
100.000 3	100.000 9	0.000 6	100.001 0	0.000 7	100.000 9	0.000 6	0.000 1
199.997 9	199.999 2	0.001 3	199.999 1	0.001 2	199.999 2	0.001 3	0.000 1
300.002 5	300.004 7	0.002 2	300.004 9	0.002 4	300.004 9	0.002 4	0.000 2
400.002 4	400.005 0	0.002 6	400.005 1	0.002 7	400.005 0	0.002 6	0.000 1
500.000 0	500.003 0	0.003 0	500.003 3	0.003 3	500.003 3	0.003 3	0.000 3

Información gráfica del error de medición de longitud E_0 para máquinas con relación de ejes largos
Graphic information of length error E_0 for machines with high aspect ratio

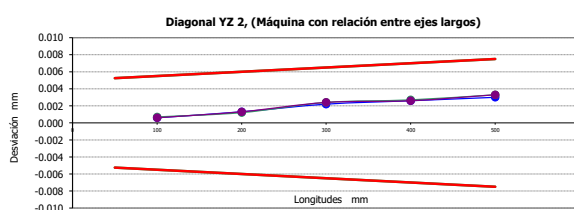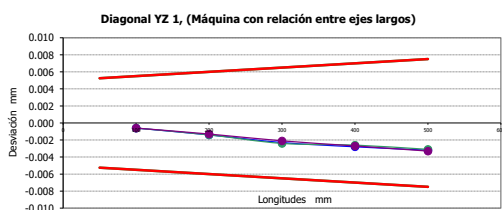

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Error de medición de longitud E_0
Length error E_0

Todos los resultados se expresan en mm

Longitud Patrón	1 era medición	E_{L1}	2 da medición	E_{L2}	3 era medición	E_{L3}	Repetibilidad
Posición 5, paralela a eje X							
50.001 8	50.001 3	-0.000 5	50.001 5	-0.000 3	50.001 5	-0.000 3	0.000 2
199.997 9	199.997 1	-0.000 8	199.997 3	-0.000 6	199.997 2	-0.000 7	0.000 2
300.002 5	300.001 4	-0.001 1	300.001 2	-0.001 3	300.001 2	-0.001 3	0.000 2
400.002 4	400.000 9	-0.001 5	400.000 7	-0.001 7	400.000 8	-0.001 6	0.000 2
500.000 0	499.997 7	-0.002 3	499.997 5	-0.002 5	499.997 7	-0.002 3	0.000 2
1099.984 4	1099.981 2	-0.003 2	1099.981 1	-0.003 3	1099.980 8	-0.003 6	0.000 4
Posición 6, paralela a eje Y							
50.001 8	50.002 1	0.000 3	50.002 0	0.000 2	50.002 2	0.000 4	0.000 2
100.000 3	100.001 4	0.001 1	100.001 6	0.001 3	100.001 7	0.001 4	0.000 3
199.997 9	199.999 3	0.001 4	199.999 5	0.001 6	199.999 4	0.001 5	0.000 2
300.002 5	300.004 1	0.001 6	300.004 3	0.001 8	300.004 2	0.001 7	0.000 2
400.002 4	400.004 7	0.002 3	400.004 8	0.002 4	400.004 9	0.002 5	0.000 2
500.000 0	500.002 8	0.002 8	500.002 7	0.002 7	500.002 6	0.002 6	0.000 2
Posición 7, paralela a eje Z							
50.001 8	50.001 5	-0.000 3	50.001 6	-0.000 2	50.001 7	-0.000 1	0.000 2
100.000 3	99.999 9	-0.000 4	100.000 0	-0.000 3	100.000 1	-0.000 2	0.000 2
199.997 9	199.996 7	-0.001 2	199.996 6	-0.001 3	199.996 8	-0.001 1	0.000 2
300.002 5	300.001 1	-0.001 4	300.000 9	-0.001 6	300.001 0	-0.001 5	0.000 2
400.002 4	400.000 8	-0.001 6	400.000 5	-0.001 9	400.000 7	-0.001 7	0.000 3
500.000 0	499.997 9	-0.002 1	499.997 8	-0.002 2	499.997 7	-0.002 3	0.000 2
Posición 1, diagonal con orientación (1,0,0) a (0,1,1)							
50.001 8	50.002 3	0.000 5	50.002 2	0.000 4	50.002 2	0.000 4	0.000 1
199.997 9	199.998 8	0.000 9	199.998 6	0.000 7	199.998 8	0.000 9	0.000 2
300.002 5	300.003 6	0.001 1	300.003 5	0.001 0	300.003 8	0.001 3	0.000 3
400.002 4	400.004 0	0.001 6	400.003 9	0.001 5	400.004 1	0.001 7	0.000 2
500.000 0	500.002 2	0.002 2	500.002 3	0.002 3	500.002 4	0.002 4	0.000 2
1099.984 4	1099.987 8	0.003 4	1099.987 9	0.003 5	1099.987 8	0.003 4	0.000 1
Posición 2, diagonal con orientación (1,1,0) a (0,0,1)							
50.001 8	50.001 4	-0.000 4	50.001 5	-0.000 3	50.001 6	-0.000 2	0.000 2
199.997 9	199.997 4	-0.000 5	199.996 9	-0.001 0	199.997 3	-0.000 6	0.000 5
300.002 5	300.001 3	-0.001 2	300.001 2	-0.001 3	300.001 4	-0.001 1	0.000 2
400.002 4	400.000 9	-0.001 5	400.000 8	-0.001 6	400.001 0	-0.001 4	0.000 2
500.000 0	499.996 6	-0.003 4	499.996 6	-0.003 4	499.996 4	-0.003 6	0.000 2
1099.984 4	1099.980 7	-0.003 7	1099.980 8	-0.003 6	1099.980 6	-0.003 8	0.000 2
Posición 3, diagonal con orientación (0,1,0) a (1,0,1)							
50.001 8	50.001 4	-0.000 4	50.001 5	-0.000 3	50.001 5	-0.000 3	0.000 1
199.997 9	199.996 8	-0.001 1	199.996 7	-0.001 2	199.996 7	-0.001 2	0.000 1
300.002 5	300.000 9	-0.001 6	300.000 9	-0.001 6	300.001 0	-0.001 5	0.000 1
400.002 4	400.000 1	-0.002 3	399.999 9	-0.002 5	400.000 2	-0.002 2	0.000 3
500.000 0	499.997 4	-0.002 6	499.997 5	-0.002 5	499.997 3	-0.002 7	0.000 2
1099.984 4	1099.980 8	-0.003 6	1099.980 7	-0.003 7	1099.981 0	-0.003 4	0.000 3
Posición 4, diagonal con orientación (0,0,0) a (1,1,1)							
50.001 8	50.001 9	0.000 1	50.002 0	0.000 2	50.002 1	0.000 3	0.000 2
199.997 9	199.998 3	0.000 4	199.998 4	0.000 5	199.998 5	0.000 6	0.000 2
300.002 5	300.004 0	0.001 5	300.004 1	0.001 6	300.003 9	0.001 4	0.000 2
400.002 4	400.004 0	0.001 6	400.004 1	0.001 7	400.004 1	0.001 7	0.000 1
500.000 0	500.002 6	0.002 6	500.002 5	0.002 5	500.002 3	0.002 3	0.000 3
1099.984 4	1099.987 8	0.003 4	1099.987 7	0.003 3	1099.987 7	0.003 3	0.000 1

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx









CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Información gráfica del error de medición de longitud E_0
Graphic information of length error E_0

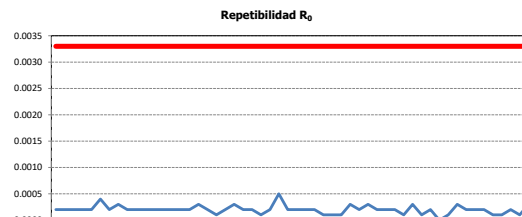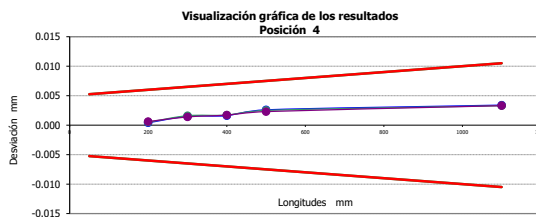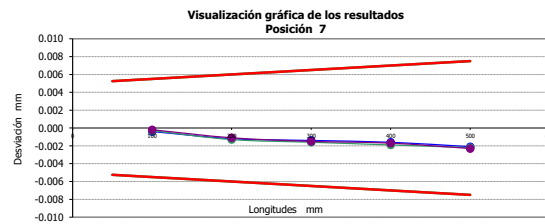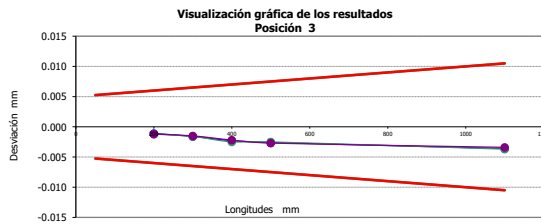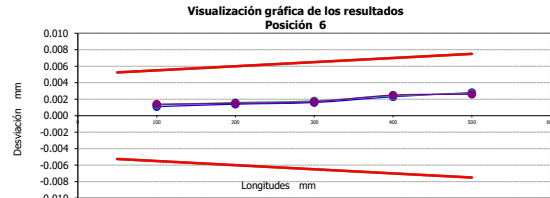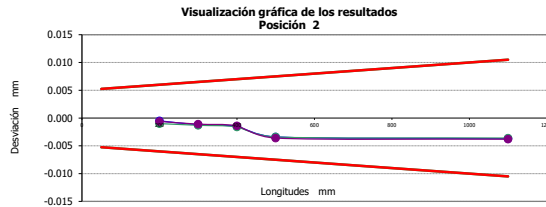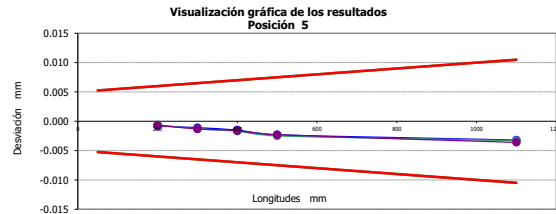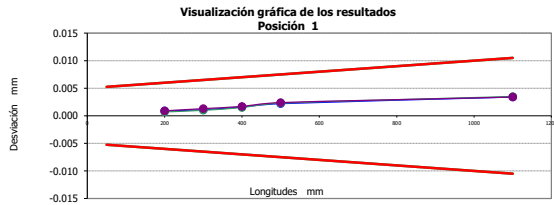

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Error de medición de longitud E_{150}



Length error E_{150}

Todos los resultados se expresan en mm

Longitud Patrón	1 era medición	E_{L1}	2 da medición	E_{L2}	3 era medición	E_{L3}	Repetibilidad
Posición 1A ZX, Diagonal 1 con L=150							
50.001 8	50.001 4	-0.000 4	50.001 5	-0.000 3	50.001 4	-0.000 4	0.000 1
199.997 9	199.997 2	-0.000 7	199.996 7	-0.001 2	199.996 3	-0.001 6	0.000 9
300.002 5	300.001 0	-0.001 5	300.001 1	-0.001 4	300.001 0	-0.001 5	0.000 1
400.002 4	400.000 2	-0.002 2	400.000 0	-0.002 4	400.000 2	-0.002 2	0.000 2
500.000 0	499.997 4	-0.002 6	499.997 3	-0.002 7	499.997 3	-0.002 7	0.000 1
1099.984 4	1099.981 0	-0.003 4	1099.980 9	-0.003 5	1099.980 7	-0.003 7	0.000 3
Posición 2A ZY, Diagonal 2 con L=150							
50.001 8	50.002 1	0.000 3	50.002 2	0.000 4	50.002 0	0.000 2	0.000 2
100.000 3	100.000 8	0.000 5	100.000 8	0.000 5	100.000 9	0.000 6	0.000 1
199.997 9	199.999 6	0.001 7	199.999 5	0.001 6	199.999 6	0.001 7	0.000 1
300.002 5	300.005 0	0.002 5	300.004 8	0.002 3	300.004 8	0.002 3	0.000 2
400.002 4	400.005 2	0.002 8	400.005 1	0.002 7	400.005 0	0.002 6	0.000 2
500.000 0	500.003 6	0.003 6	500.003 5	0.003 5	500.003 4	0.003 4	0.000 2

Información gráfica del error de medición de longitud E_{150}

Graphic information of length error E_{150}

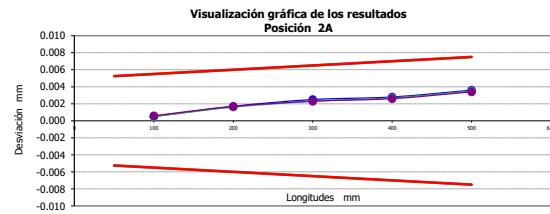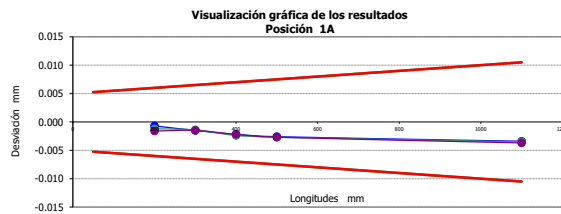

Error de palpado $P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$
Probing error

(0.0021 ± 0.0002) mm

Error de palpado $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$
Probing error

(0.00123 ± 0.00067) mm

Requerimientos especiales (Special requirements)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
COMENTO
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

FIN DE DOCUMENTO.

