

Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 1			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.03	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.10	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.40	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.00	0.47	

The graph displays five data points representing calibration measurements. Each point consists of a blue dot (mean value) and a vertical black error bar (uncertainty). The x-axis is labeled from -20.00 to 70.00 in increments of 10.00. The y-axis is labeled from -1.00 to 0.60 in increments of 0.20. The data points are approximately at (-10, -0.03), (-1, -0.60), (20, -0.10), (40, -0.40), and (60, 0.00). The error bars vary in length, with the largest error bar at 60 °C.

Point	Reference Value (K)	Average UUT (°C)	Reference Value (°C)	Instrumental Bias (°C)	Measurement Uncertainty (°C)
1	263.15	-10	-10.00	-0.03	0.20
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21
3	293.15	20	20.00	-0.10	0.24
4	313.15	40	40.00	-0.40	0.28
5	333.15	60	60.00	0.00	0.47

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

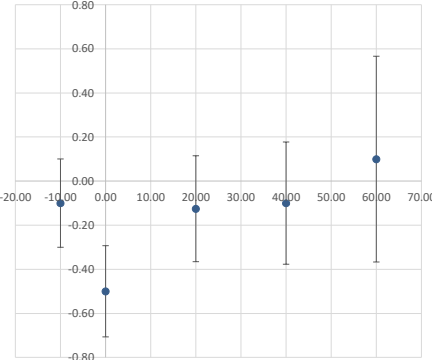


Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 2			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.10	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.50	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.13	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.10	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.10	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Grafic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 3			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.70	0.21	
3	293.15	20	20.00	0.02	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.10	0.28	
5	333.15	60	60.00	-0.20	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Grafic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 4			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrimental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.03	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.50	0.21	
3	293.15	20	20.00	0.02	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.05	0.28	
5	333.15	60	60.00	-0.07	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 5			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.10	0.21	
2	273.15	0	0.00	-0.30	0.82	
3	293.15	20	20.00	0.00	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.02	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.00	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 6			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.13	0.22	
2	273.15	-1	0.00	-0.50	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.05	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.15	0.29	
5	333.15	60	60.00	-0.05	0.46	

Point #	Reference Value (K)	Promedio IBC (°C)	Reference Value (°C)	Instrumental Bias (°C)	Measurement Uncertainty (°C)
1	263.15	-10	-10.00	0.13	0.22
2	273.15	-1	0.00	-0.50	0.21
3	293.15	20	20.00	-0.05	0.24
4	313.15	40	40.00	-0.15	0.29
5	333.15	60	60.00	-0.05	0.46

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a <i>(to)</i> 400 °C			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 7			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.21	
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.20	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.15	0.29	
5	333.15	60	60.00	-0.07	0.46	

Temperature (°C)	Voltage (mV)	Uncertainty (mV)
-10	-0.00	0.21
0	-0.60	0.21
20	-0.20	0.24
40	-0.15	0.29
60	-0.07	0.46

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 8			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.21	
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.20	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.15	0.29	
5	333.15	60	60.00	-0.07	0.46	

Point #	Reference Temp (K)	Reference Temp (°C)	Reference Value (mV)	Instrumental Bias (mV)	Measurement Uncertainty (mV)
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.21
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21
3	293.15	20	20.00	-0.20	0.24
4	313.15	40	40.00	-0.15	0.29
5	333.15	60	60.00	-0.07	0.46

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 9			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.90	0.21	
3	293.15	20	20.00	0.00	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.10	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.10	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 10			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.10	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.90	0.21	
3	293.15	20	20.00	0.00	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.00	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.20	0.47	

Temperature (°C)	Voltage (mV)	Instrumental Bias (mV)	Measurement Uncertainty (mV)
20	-0.00	-0.90	0.24
40	-0.00	0.00	0.28
60	0.20	0.20	0.47

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

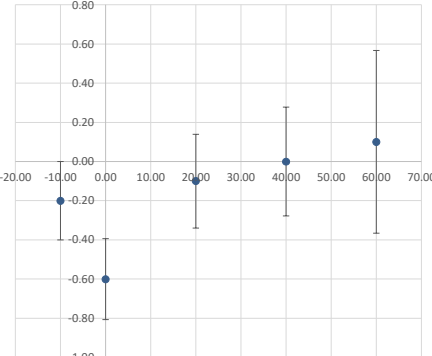


Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 11			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.20	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.10	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.00	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.10	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 12			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.10	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.50	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.10	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.10	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.10	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 13			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.03	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.10	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.40	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.00	0.47	

Temperature (°C)	Voltage (mV)	Uncertainty (mV)
10	-0.03	0.20
20	-0.60	0.21
40	-0.10	0.24
60	-0.40	0.28

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 14			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.10	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.50	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.13	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.10	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.10	0.47	

Temperature (°C)	Voltage (mV)	Uncertainty (mV)
-10	-0.10	±0.20
0	-0.50	±0.21
20	-0.13	±0.24
40	-0.10	±0.28
60	0.10	±0.47

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 15			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.70	0.21	
3	293.15	20	20.00	0.02	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.10	0.28	
5	333.15	60	60.00	-0.20	0.47	

Reference Value (°C)	Measurement Uncertainty (°C)
-10	-0.05
20	-0.02
40	0.10
60	-0.20

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

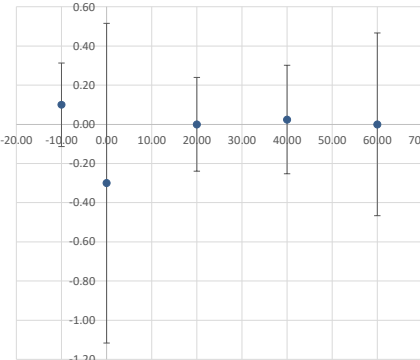


Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 16			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.10	0.21	
2	273.15	0	0.00	-0.30	0.82	
3	293.15	20	20.00	0.00	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.02	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.00	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 17			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.21	
2	273.15	-1	0.00	-0.60	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.20	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.15	0.29	
5	333.15	60	60.00	-0.07	0.46	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 18			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.00	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.70	0.21	
3	293.15	20	20.00	0.02	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.10	0.28	
5	333.15	60	60.00	-0.20	0.47	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 19			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	0.13	0.22	
2	273.15	-1	0.00	-0.50	0.21	
3	293.15	20	20.00	-0.05	0.24	
4	313.15	40	40.00	-0.15	0.29	
5	333.15	60	60.00	-0.05	0.46	

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



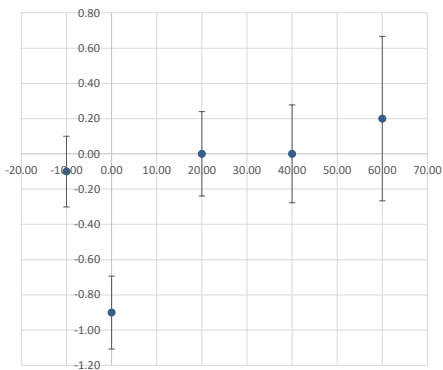
Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Resultados de la calibración
(Calibration results)

	Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "IN mV" Canal 1- (Termopar K) (Temperature "IN mV" Channel 1- (Thermocouple K)				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
	Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-200 °C a 400 °C <i>(to)</i>			
	Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C	CHANNEL 20			
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average UUT)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Sesgo instrumental <i>(Instrumental bias)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>	
#	K	°C	°C	°C	°C	
1	263.15	-10	-10.00	-0.10	0.20	
2	273.15	-1	0.00	-0.90	0.21	
3	293.15	20	20.00	0.00	0.24	
4	313.15	40	40.00	0.00	0.28	
5	333.15	60	60.00	0.20	0.47	



The graph displays the calibration results for the temperature measurement system. The x-axis represents the reference temperature in Kelvin (K), ranging from -20.00 to 70.00. The y-axis represents the measurement uncertainty in degrees Celsius (°C), ranging from -1.20 to 0.80. Five data points are plotted, each with a vertical error bar representing the measurement uncertainty. The points are located at approximately (-10, -0.10), (-1, -0.90), (20, 0.00), (40, 0.00), and (60, 0.20). The error bars for the first three points are relatively small, while the error bar for the last point at 60 K is significantly larger, extending from approximately -0.30 to 0.65 °C.

Point	Reference Value (K)	Average UUT (°C)	Instrumental Bias (°C)	Measurement Uncertainty (°C)	
1	263.15	-10	-10.00	-0.10	0.20
2	273.15	-1	0.00	-0.90	0.21
3	293.15	20	20.00	0.00	0.24
4	313.15	40	40.00	0.00	0.28
5	333.15	60	60.00	0.20	0.47

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

N/A

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



Observaciones generales
(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.
(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
(The results and uncertainty levels declared in this calibration certificate correspond exclusively to the instrument described in sheet 1)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos 95 % aproximadamente.
(The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k=2$, which assures the confidence level of less than about 95 %)

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

Descripción del método:
(Description of method)

- El valor actual se obtiene de un promedio de 5 mediciones realizadas para cada punto.
(The current value is obtained from an average of 5 evaluations performed for each point)

- El sesgo instrumental se obtiene de la diferencia entre el promedio de lecturas indicado por el IBC y el valor de referencia.
(Instrumental bias is obtained from the difference between the average readings indicated by the UUT and the reference value)

- El método de calibración es de medición directa mediante simulación eléctrica, en el cual el equipo patrón envía una señal de valor conocido en milivoltaje y que el ibc interpreta en unidades de temperatura.
(The calibration method is direct measurement through electrical simulation, in which the standard equipment sends a signal of known value in millivoltage and that the UUT interprets in temperature units.)

- Kelvin
(Kelvin)

$$^{\circ}\text{C} = \left(\frac{5}{9}\right) * (^{\circ}\text{F} - 32)$$

- grado Celsius
(Celsius degree)

$$K = ^{\circ}\text{C} + 273,15$$

- grado Fahrenheit
(Fahrenheit degree)

$$^{\circ}\text{F} = \left(\frac{9}{5}\right) * ^{\circ}\text{C} + 32$$

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

