



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	6	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.6	0.601	0.601	0.601	0.601	0.601	0.001	2.00	0.0016
2	1.5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.000	2.00	0.0019
3	3	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	-0.002	2.00	0.011
4	4.5	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	0.002	2.00	0.012
5	5.4	5.404	5.404	5.404	5.404	5.404	0.004	2.00	0.013

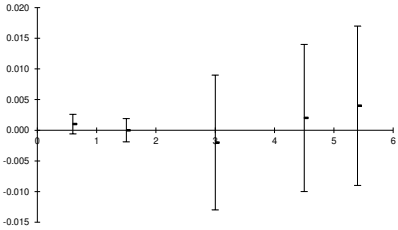


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	60	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	6	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	0.01	2.00	0.014
2	15	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	0.01	2.00	0.017
3	30	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	0.02	2.00	0.12
4	45	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	0.03	2.00	0.12
5	54	54.04	54.04	54.04	54.04	54.04	0.04	2.00	0.13

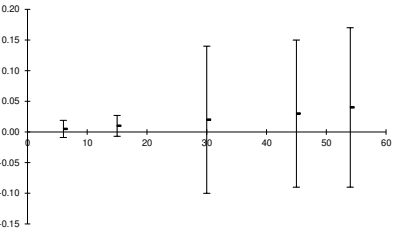

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	600	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	60	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	0.00	2.00	0.14
2	150	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	0.00	2.00	0.17
3	300	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	0.00	2.00	0.90
4	450	450.1	450.1	450.1	450.1	450.1	0.10	2.00	0.98
5	540	540.2	540.2	540.2	540.2	540.2	0.20	2.00	1.0

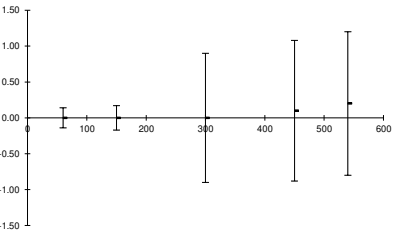

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	1000	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	100	100	100	100	100	0.00	2.00	0.60
2	250	250	250	250	250	250	0.00	2.00	1.0
3	500	500	500	500	500	500	0.00	2.00	1.2
4	750	751	751	751	751	751	1.00	2.00	1.3
5	900	901	901	901	901	901	1.00	2.00	1.4

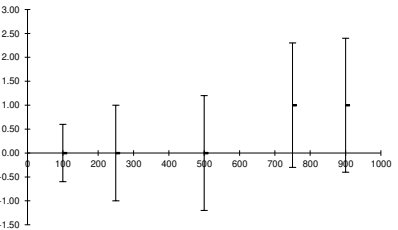

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándose este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.
- o El fusible interno del instrumento para los intervalos de medición de corriente eléctrica (440 mA) se encuentra "abierto", para poder realizar la calibración, fue empleado un fusible propiedad de MESS.
- o The fuse for electrical 440 mA current measurements range its "open", the calibration for this range was developed with a Mess fuse.