



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	-0.16	2.00	0.058
2	50	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	-0.20	2.00	0.058
3	100	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	-0.40	2.00	0.059
4	150	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	-0.50	2.00	0.059
5	180	179.4	179.4	179.4	179.4	179.4	-0.60	2.00	0.059




Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2000	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	200	199	199	199	199	199	-1.0	2.00	0.58
2	500	499	499	499	499	499	-1.0	2.00	0.60
3	1000	999	999	999	999	999	-1.0	2.00	0.61
4	1500	1498	1498	1498	1498	1498	-2.0	2.00	0.61
5	1800	1798	1798	1798	1798	1798	-2.0	2.00	0.61



Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	-0.01	2.00	0.0058
2	5	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	-0.01	2.00	0.0059
3	10	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	-0.01	2.00	0.0059
4	15	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99	-0.01	2.00	0.0059
5	18	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99	-0.01	2.00	0.0059




Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	-0.1	2.00	0.058
2	50	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	-0.1	2.00	0.059
3	100	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.1	2.00	0.060
4	150	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	0.0	2.00	0.060
5	180	180.1	180.1	180.1	180.1	180.1	0.1	2.00	0.060




Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2000	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	200	200	200	200	200	200	0.00	2.00	0.59
2	500	499	499	499	499	499	-1.00	2.00	0.59
3	1000	998	998	998	998	998	-2.00	2.00	0.59
4	1500	1498	1498	1498	1498	1498	-2.00	2.00	0.88
5	1800	1798	1798	1798	1798	1798	-2.00	2.00	0.89




Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	-0.01	2.00	0.0058
2	5	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	-0.01	2.00	0.0059
3	10	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	-0.02	2.00	0.0059
4	15	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	-0.02	2.00	0.0070
5	18	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	-0.02	2.00	0.0071



Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	-0.10	2.00	0.058
2	50	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	-0.10	2.00	0.058
3	100	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.10	2.00	0.059
4	150	149.8	149.8	149.8	149.8	149.8	-0.20	2.00	0.072
5	180	179.8	179.8	179.8	179.8	179.8	-0.20	2.00	0.074

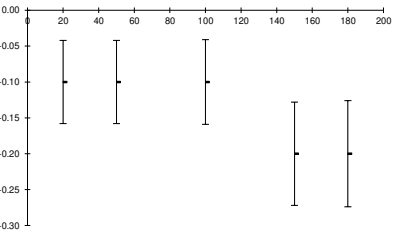


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2000	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	200	199	199	199	199	199	-1.0	2.00	0.58
2	500	499	499	499	499	499	-1.0	2.00	0.58
3	1000	999	999	999	999	999	-1.0	2.00	0.59
4	1500	1503	1503	1503	1503	1503	3.0	2.00	1.5
5	1800	1805	1805	1805	1805	1805	5.0	2.00	1.5




Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1000	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	99	99	99	99	99	-1.0	2.00	0.58
2	250	249	249	249	249	249	-1.0	2.00	0.58
3	500	500	500	500	500	500	0.0	2.00	0.58
4	750	752	752	752	752	752	2.0	2.00	0.58
5	900	903	903	903	903	903	3.0	2.00	0.58




Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Frec (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	-0.70	2.00	0.061
2	50	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	-1.00	2.00	0.14
3	100	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	-1.40	2.00	0.16
4	150	148.1	148.1	148.1	148.1	148.1	-1.90	2.00	0.17
5	180	177.8	177.8	177.8	177.8	177.8	-2.20	2.00	0.19

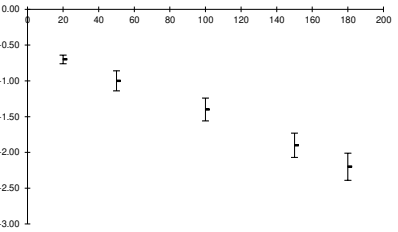

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	750	Frec (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	75	73	73	73	73	73	-2.0	2.00	0.59
2	187.5	185	185	185	185	185	-2.5	2.00	0.61
3	375	371	371	371	371	371	-4.0	2.00	1.1
4	562.5	558	558	558	558	558	-4.5	2.00	1.2
5	675	670	670	670	670	670	-5.0	2.00	1.2

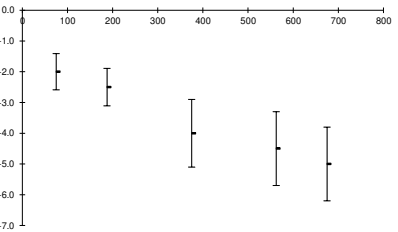


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	0.20	2.00	0.11
2	50	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.00	2.00	0.11
3	100	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	-0.40	2.00	0.11
4	150	149.3	149.3	149.3	149.3	149.3	-0.70	2.00	0.11
5	180	179.1	179.1	179.1	179.1	179.1	-0.90	2.00	0.11

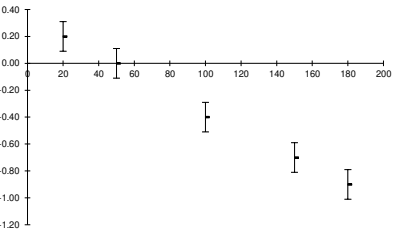


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	200	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	-0.2	2.00	0.066
2	50	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	-0.3	2.00	0.071
3	100	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	-0.4	2.00	0.079
4	150	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	-0.5	2.00	0.089
5	180	179.4	179.4	179.4	179.4	179.4	-0.6	2.00	0.096




Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	2000	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	200	198	198	198	198	198	-2.0	2.00	0.58
2	500	497	497	497	497	497	-3.0	2.00	0.69
3	1000	996	996	996	996	996	-4.0	2.00	0.73
4	1500	1495	1495	1495	1495	1495	-5.0	2.00	0.78
5	1800	1795	1795	1795	1795	1795	-5.0	2.00	0.80

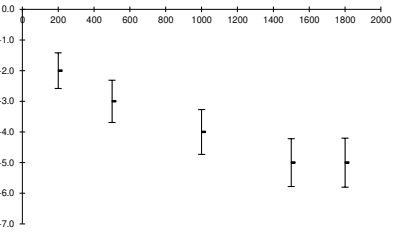

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	20	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.02	2.00	0.0058
2	5	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	-0.04	2.00	0.0075
3	10	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	-0.07	2.00	0.0079
4	15	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	-0.09	2.00	0.0084
5	18	17.89	17.89	17.89	17.89	17.89	-0.11	2.00	0.0087

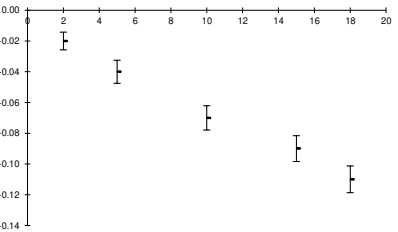


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	200	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	-0.2	2.00	0.058
2	50	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	-0.3	2.00	0.069
3	100	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	-0.6	2.00	0.073
4	150	149.3	149.3	149.3	149.3	149.3	-0.7	2.00	0.078
5	180	179.2	179.2	179.2	179.2	179.2	-0.8	2.00	0.080



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	-0.01	2.00	0.0058
2	2.5	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	-0.02	2.00	0.0065
3	5	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	-0.03	2.00	0.0076
4	7.5	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	-0.05	2.00	0.0090
5	9	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	-0.07	2.00	0.010



Transmille 1000

Transmille 1000

Transmille 1000

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.