



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Valor nominal [mΩ]	Corriente de prueba [A]	±	Incertidumbre k=2 [A]	Tensión Medida* [V]	±	Incertidumbre k=2* [V]	Resistencia Ref* [mΩ]	Error * [mΩ]	±	Incertidumbre k=2* [mΩ]
1	0.3	±	0.000 20	0.000 301 6	±	0.000 001 1	1.005 38	-0.005 38	±	0.000 44
	0.75	±	0.000 32	0.000 754 4	±	0.000 001 1	1.005 78	-0.005 78	±	0.000 32
	1.5	±	0.000 51	0.001 508 9	±	0.000 001 1	1.005 87	-0.005 87	±	0.000 51
	2.25	±	0.002 0	0.002 263 2	±	0.000 001 1	1.005 78	-0.005 78	±	0.002 0
	2.7	±	0.002 2	0.002 718 0	±	0.000 001 1	1.006 57	-0.006 57	±	0.002 2

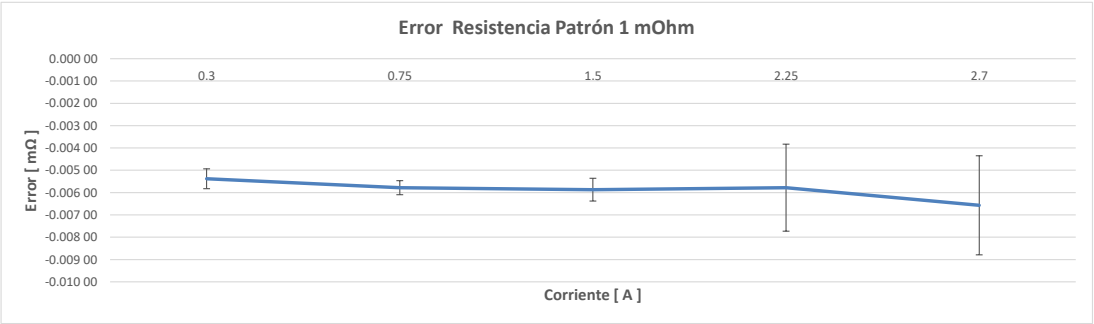

Valor nominal [mΩ]	Corriente de prueba [A]	±	Incertidumbre k=2 [A]	Tensión Medida* [V]	±	Incertidumbre k=2* [V]	Resistencia Ref* [mΩ]	Error * [mΩ]	±	Incertidumbre k=2* [mΩ]
1	0.5	±	0.000 25	0.000 503 6	±	0.000 001 1	1.007 13	-0.007 13	±	0.000 26
	1.25	±	0.000 45	0.001 257 8	±	0.000 001 1	1.006 20	-0.006 20	±	0.000 4
	2.5	±	0.002 1	0.002 515 3	±	0.000 001 1	1.006 02	-0.006 02	±	0.002 1
	3.75	±	0.002 9	0.003 771 3	±	0.000 001 1	1.005 60	-0.005 60	±	0.002 9
	4.5	±	0.003 3	0.004 533 4	±	0.000 001 1	1.007 33	-0.007 33	±	0.003 3

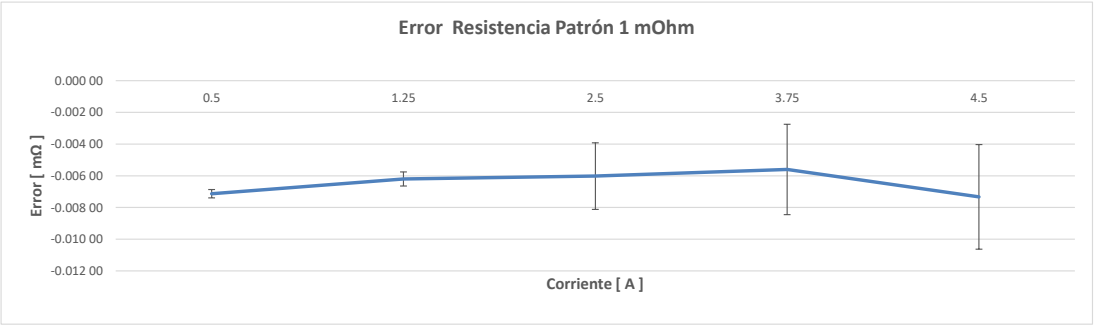

* Puntos fuera del alcance acreditado

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..

o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

The use of calibration results is the responsibility of the user.

o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.

The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.

The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.

o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".

The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"

o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.

o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measuremen error calculation.

o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.

o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.