

Resultados de la calibración
(Calibration results)


Sentido: (Sense)	Compresión
Resolución: (Resolution)	1 N

Lecturas de equipo bajo calibración (IBC) (Equipment readings under calibration)		Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))				
N	--	1ª serie 0° Ascenso (Ascent)	2ª serie 120° Ascenso (Ascent)	3ª serie 240° Ascenso (Ascent)	Promedio (Average)	
		N	N	N	N	--
1 000.000	--	988.961	989.005	989.094	989.020	--
2 000.000	--	1 980.644	1 981.090	1 981.981	1 981.238	--
3 000.000	--	2 970.189	2 971.081	2 968.852	2 970.041	--
4 000.000	--	3 962.685	3 964.467	3 963.576	3 963.576	--
5 000.000	--	4 953.693	4 953.248	4 952.802	4 953.248	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))	Equipo bajo calibración (IBC) (Equipment under calibration)	Error relativo de repetibilidad (Repeatability relative error) "b"	Error relativo de exactitud (Relative accuracy error) "q"		Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty)	
N	N	%L	%L	N	%L	N
989.020	1 000.000	0.013	1.110	10.980	7.0E-02	6.9E-01
1 981.238	2 000.000	0.068	0.947	18.762	1.4E-01	2.7E+00
2 970.041	3 000.000	0.075	1.009	29.959	1.4E-01	4.0E+00
3 963.576	4 000.000	0.045	0.919	36.424	1.0E-01	4.1E+00
4 953.248	5 000.000	0.018	0.944	46.752	8.4E-02	4.2E+00
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

Error de cero (fo): (Zero error)	0.0E+00 % L
-------------------------------------	-------------

Gráfica del error relativo de exactitud (Compresión)
(Graph of relative accuracy error (Compression))

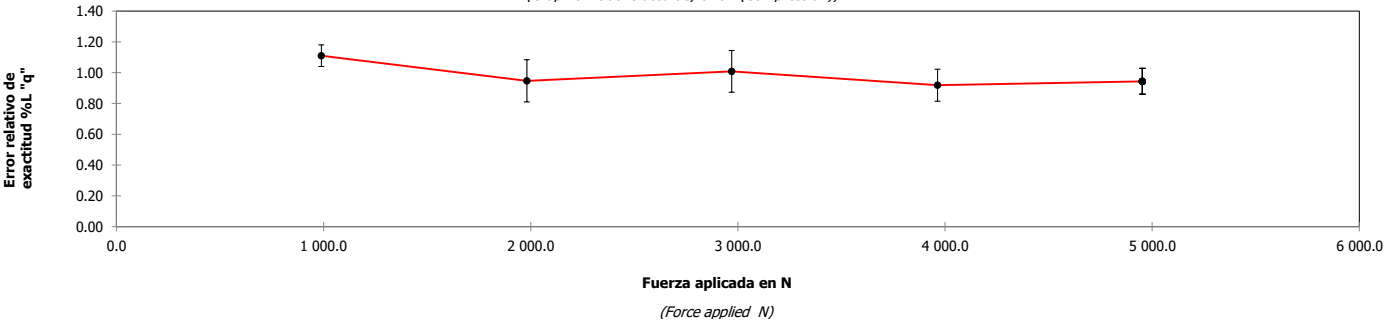

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)