Resultados de la calibración
(Calibration results)

Exteriores *(Exterior)*			
Punto *(Point)*	**Valor nominal** *(Nominal value)* mm	**Error de indicación** *(Indication error)* mm	**Incertidumbre de medida** *(Measurement uncertainty)* mm
1	0.000	0.000 0	0.008 4
2	1.010	-0.002 0	0.008 4
3	5.000	-0.002 0	0.008 4
4	12.000	0.002 0	0.008 5
5	25.000	0.000 0	0.008 5
6	50.000	0.002 0	0.008 5
7	70.000	0.004 0	0.008 5
8	100.000	0.000 0	0.008 6
9	150.000	0.000 0	0.008 7
10	200.000	0.000 0	0.008 9

Errores de corrimiento *(Shift errors)* mm		
Puntas	Valor	U (k=2)
Interiores	0.012 0	0.007 3
Profundidad	0.004 0	0.007 0
Escalón	0.010 0	0.005 8

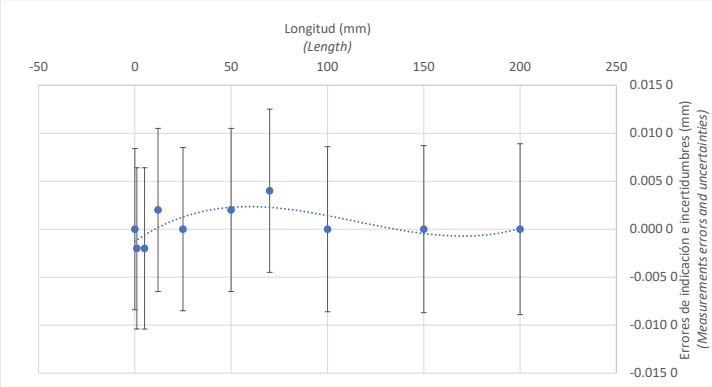

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

El instrumento presenta golpes y rayones.

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

A prescripción del cliente, se documenta y aplica la siguiente declaración de conformidad, así como la próxima fecha de calibración.
La tolerancia que el cliente emplea para este equipo es: ± 0.030 mm
La regla de decisión aplicada por el laboratorio y aceptada por el cliente corresponde a: LI+U<RESULTADO DE MEDIDA<LS-U. EL EQUIPO CUMPLE.
La declaración de conformidad se aplica únicamente a los datos indicados en la hoja de resultados del presente certificado.
Los resultados obtenidos qué se encuentran dentro de tolerancia, están manifestados en la página 2.
En esta declaración de conformidad; el laboratorio no considera adicionalmente el nivel de riesgo, debido a que la regla es prescrita por el cliente.
A requerimiento del cliente se menciona la orden de compra. PO #14571
Frecuencia de calibración: 12 Meses.