


Resultados de la calibración
(Results of calibration)

Punto (Point)	Valor nominal (Nominal Value) mm	Error de medida (Measurement Error) µm	U± (k=2) µm
	POSICIONES		
1	2.00	-0.54	2.7
2	4.00	0.27	2.7
3	6.00	-1.71	2.7
4	8.00	-0.69	2.7
5	10.00	1.12	2.7

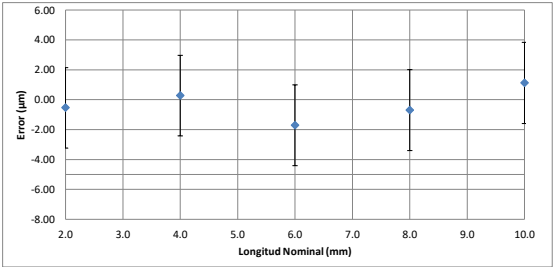

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Sin comentarios.

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

A solicitud del cliente se calibraron puntos específicos.