


Resultados de la calibración
(Calibration Results)

Prueba de diámetro efectivo (Diameter effective test)		
No	Resultado de medición (Measured value)	Error de indicación (Indication Error)
1	29.993	-0.007
2	29.993	-0.007
3	29.991	-0.009
Diámetro calibrado del patrón: (Calibrated diameter of the standard)		30.0000
Desviación Máxima: (Maximum Deviation)		0.0089
Incertidumbre expandida: (Expanded uncertainty)		0.0035

Prueba de articulación en un solo punto (Single point articulation test)			
No	0% - 20%	20% - 80%	80% - 100%
	δ_i		
1	0.007	0.011	0.006
2	0.004	0.008	0.003
3	0.007	0.002	0.006
4	0.006	0.007	0.008
5	0.012	0.010	0.003
6	0.012	0.003	0.005
7	0.001	0.004	0.006
8	0.005	0.004	0.001
9	0.004	0.003	0.006
10	0.008	0.008	0.005
δ_{max}	0.012	0.011	0.008
S_{SPAT}	0.008	0.007	0.006

Gráfica 1.- Prueba de articulation en un solo punto
(Single point articulation test graphic)

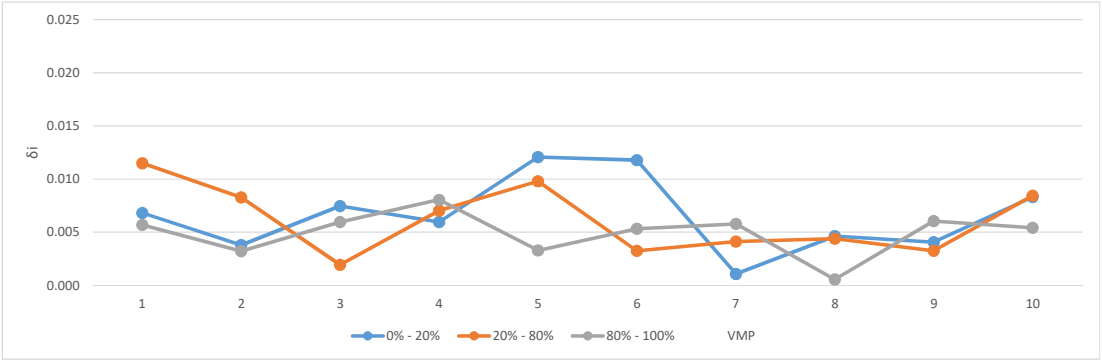

Todos los valores en mm

Resultados de la calibración
(Calibration Results)

Prueba volumétrica (Volumetric test)		
Posición (Position)	Resultado (Result)	Desviación (Deviation)
1	719.889	-0.007
2	719.892	-0.005
3	719.895	-0.002
4	719.889	-0.007
5	719.894	-0.003
6	719.884	-0.012
7	719.886	-0.011
8	1519.983	0.004
9	719.900	0.003
10	1519.985	0.006
11	719.883	-0.014
12	719.900	0.003
13	719.894	-0.003
14	719.884	-0.013
15	719.903	0.007
16	719.901	0.004
17	719.889	-0.007
18	1519.983	0.003
19	1519.982	0.002
20	1519.968	-0.011

Resultados de la prueba volumétrica (Results of volumetric test)		
Parámetro (Parameter)	Corta (Short)	Larga (Long)
Longitud del patrón: (Length of the standard)	719.897	1519.979
Desviación máxima: (Maximun deviation)	0.014	0.011
Rango de las desviaciones: (Range of deviations)	0.021	0.017
2RMS: (2RMS)	0.015	
Incertidumbre expandida: (Expanded uncertainty)	0.009	0.009

Gráfica 2.- Prueba volumétrica
(Volumetric test graphic)


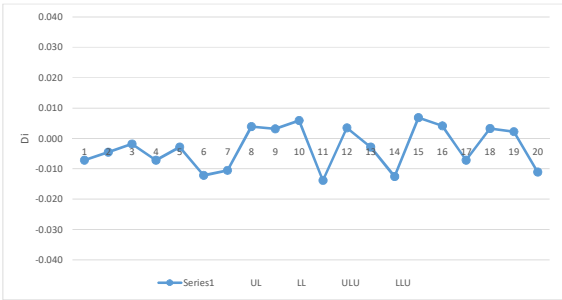


Imagen 1.- Mapa de posiciones
(Map position image)

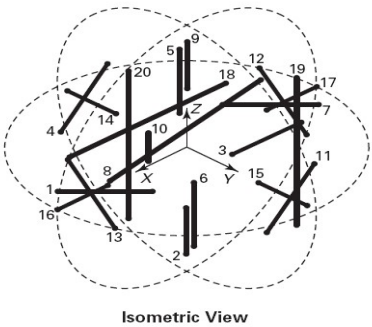

Todos los valores en mm