


Resultados de la calibración
(Calibration Results)

Prueba de diámetro efectivo (Diameter effective test)		
No	Resultado de medición (Measured value)	Error de indicación (Indication Error)
1	29.996	-0.004
2	29.997	-0.003
3	29.991	-0.009
Diámetro calibrado del patrón: (Calibrated diameter of the standard)		30.0000
Desviación Máxima: (Maximum Deviation)		0.0089
Incertidumbre expandida: (Expanded uncertainty)		0.0087

Prueba de articulación en un solo punto (Single point articulation test)			
No	0% - 20%	20% - 80%	80% - 100%
	δ_i		
1	0.011	0.004	0.008
2	0.009	0.001	0.001
3	0.002	0.002	0.001
4	0.008	0.002	0.003
5	0.008	0.004	0.006
6	0.006	0.009	0.002
7	0.006	0.008	0.003
8	0.005	0.007	0.003
9	0.004	0.005	0.005
10	0.008	0.008	0.004
δ_{max}	0.011	0.009	0.008
S_{SPAT}	0.008	0.006	0.004

Gráfica 1.- Prueba de articulation en un solo punto
(Single point articulation test graphic)

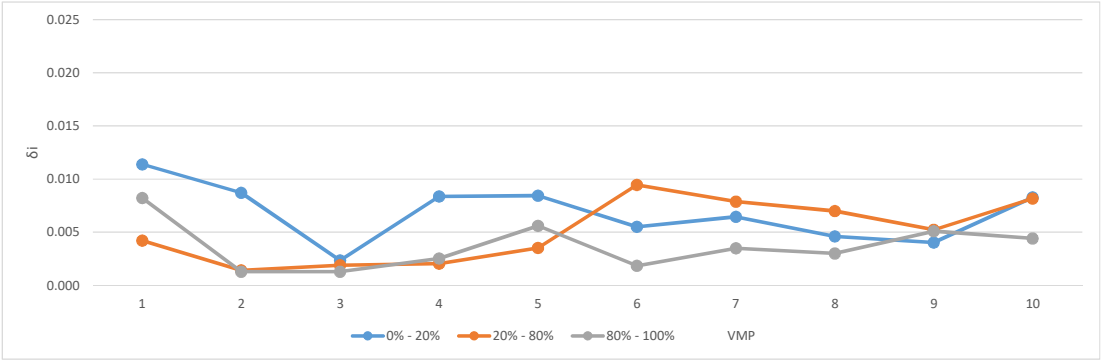

Todos los valores en mm

Resultados de la calibración
(Calibration Results)

Prueba volumétrica (Volumetric test)		
Posición (Position)	Resultado (Result)	Desviación (Deviation)
1	719.899	0.003
2	719.901	0.004
3	719.904	0.008
4	719.891	-0.006
5	719.909	0.012
6	719.901	0.004
7	719.893	-0.003
8	1519.970	-0.009
9	719.891	-0.006
10	1519.989	0.009
11	719.908	0.012
12	719.892	-0.004
13	719.901	0.004
14	719.901	0.004
15	719.890	-0.007
16	719.887	-0.010
17	719.889	-0.008
18	1519.990	0.010
19	1519.986	0.007
20	1519.987	0.007

Resultados de la prueba volumétrica (Results of volumetric test)		
Parámetro (Parameter)	Corta (Short)	Larga (Long)
Longitud del patrón: (Length of the standard)	719.897	1519.979
Desviación máxima: (Maximun deviation)	0.012	0.010
Rango de las desviaciones: (Range of deviations)	0.022	0.020
2RMS: (2RMS)	0.015	
Incertidumbre expandida: (Expanded uncertainty)	0.008	0.008

Gráfica 2.- Prueba volumétrica
(Volumetric test graphic)


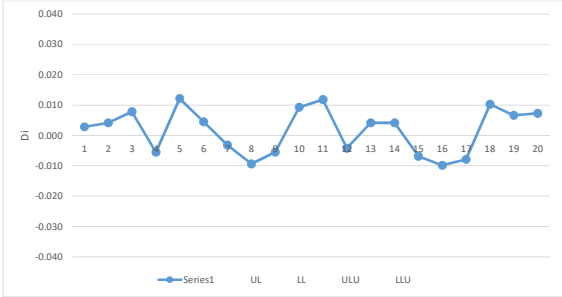


Imagen 1.- Mapa de posiciones
(Map position image)

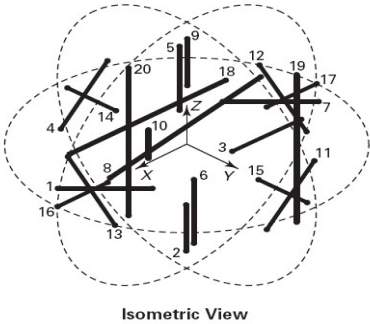

Todos los valores en mm