


**Patrón Nacional del:**  
**NIST**

*PATRÓN PRIMARIO: NIST*

**Bloques de prueba SRM**  
 No. Serie : 1894A,1896,1909  
 Calibrado por BUEHLER con acreditación:  
 a2La #2237.01

*PATRÓN DE REFERENCIA: BUEHLER*

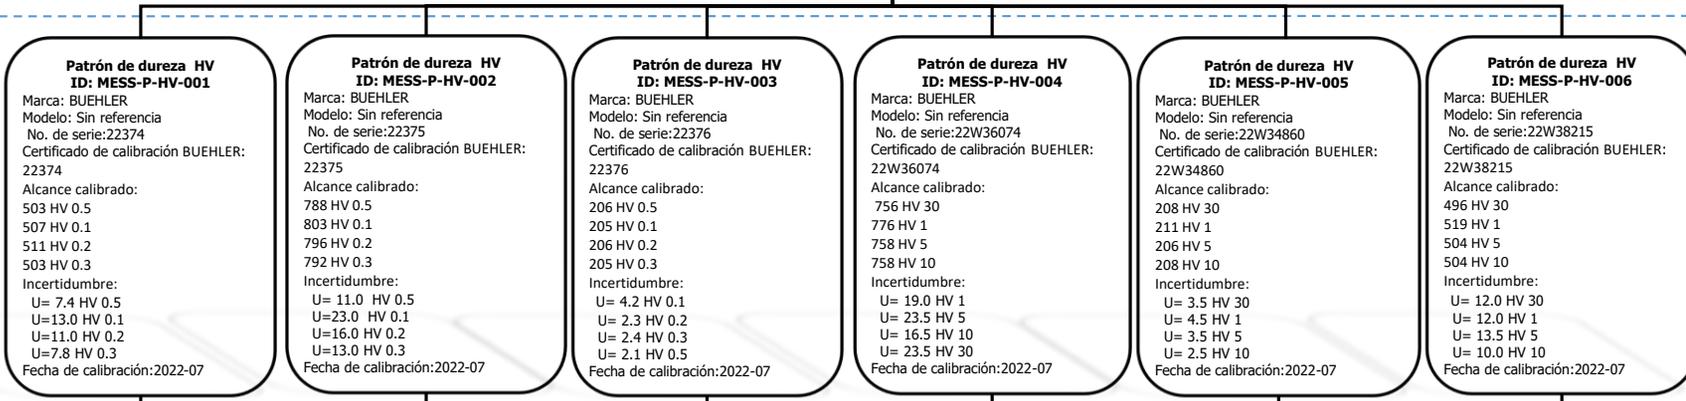

*PATRONES DE REFERENCIA : MESS*

**Item Calibrado**

*ITEM DEL CLIENTE*

**Vigencia : Hasta la vida útil del patrón**

*U=Ver certificado de calibración*

Elaboró:  
  
 Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:  
  
 Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:  
  
 Ing. Hector Julian Losoyo Vega



Fecha de revisión: 2022-09-20