


**Patrón Nacional de Masa
prototipo N° 21**

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

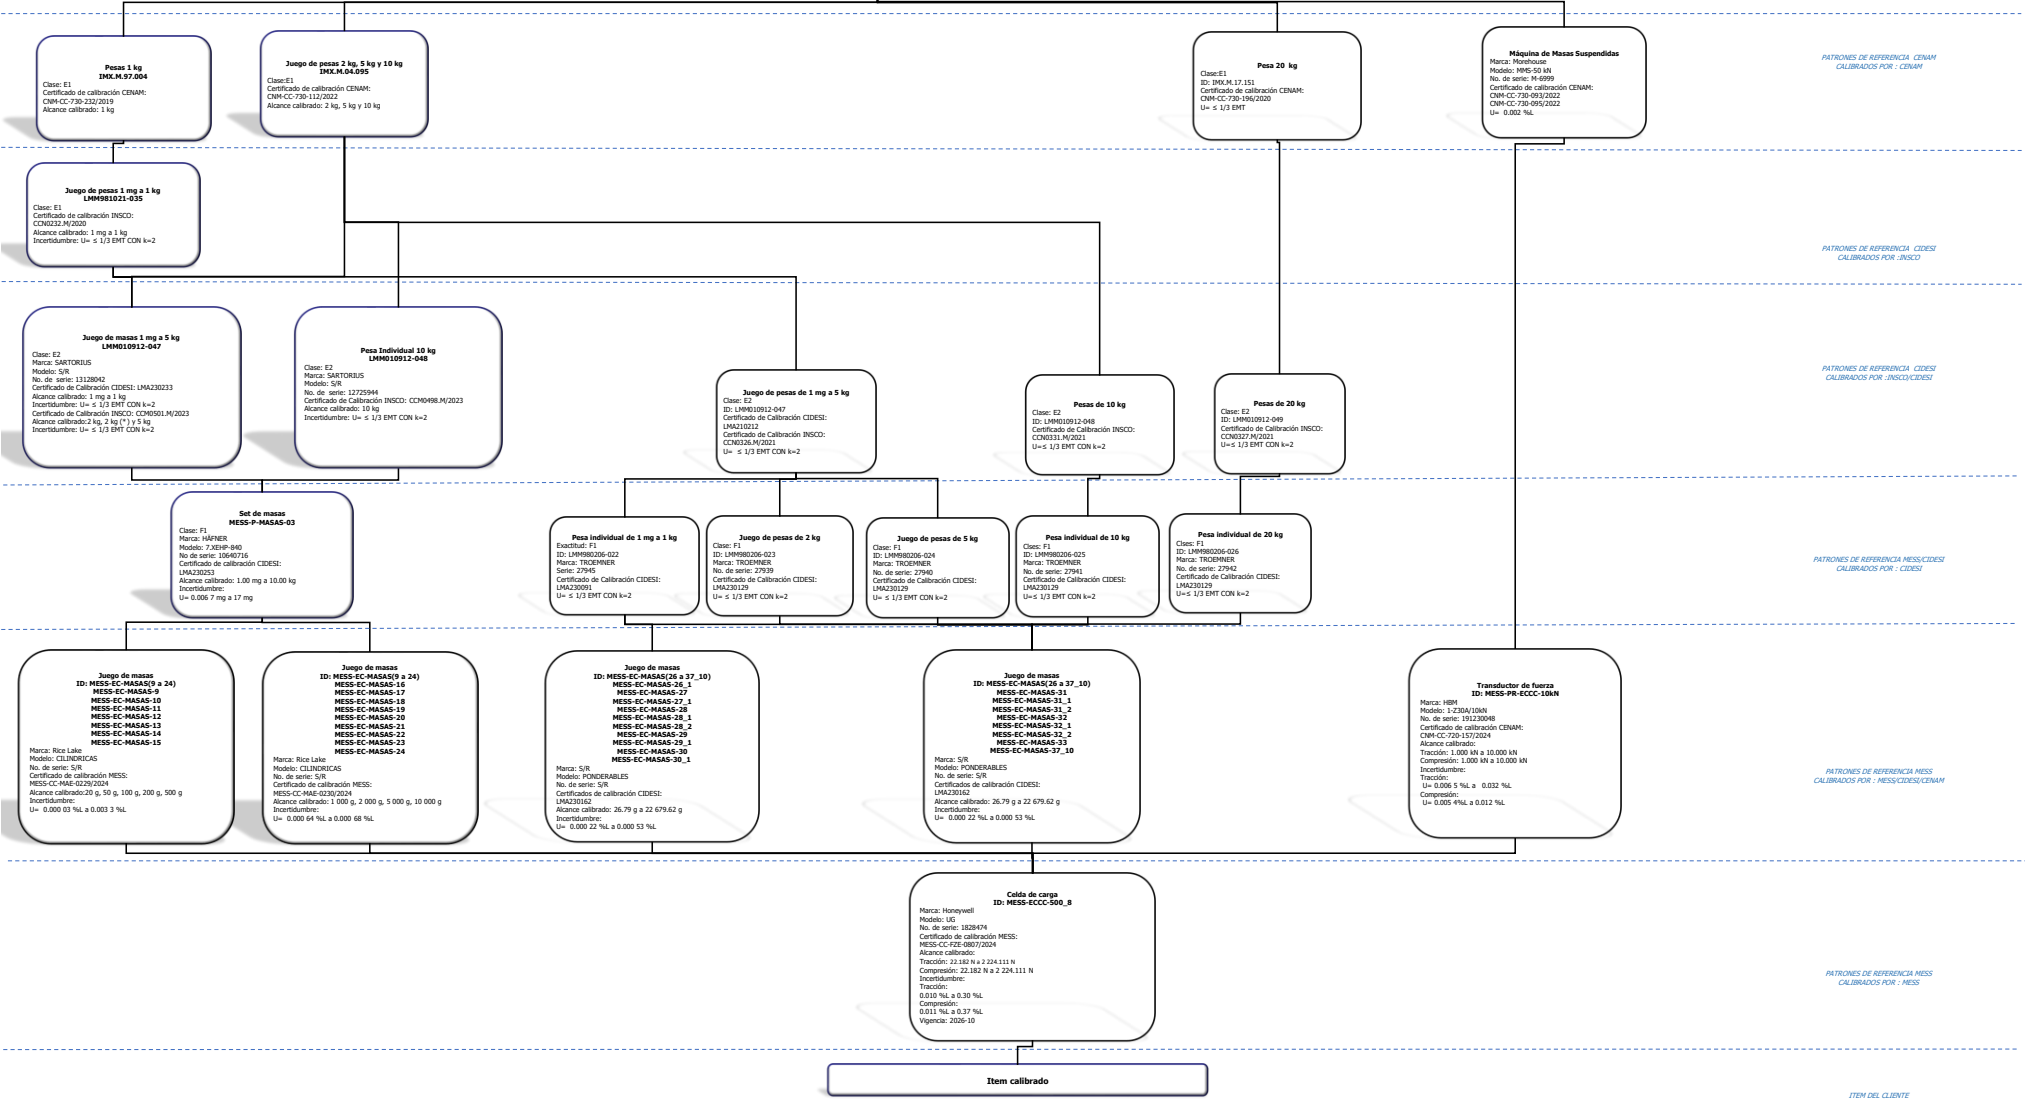

Item calibrado

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:

Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

Ing. Juan Gerardo Delgado Méndez.



Fecha de revisión: 2024-11-04