


Patrón Nacional de Temperatura
CENAM: CNM-PNE-2

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

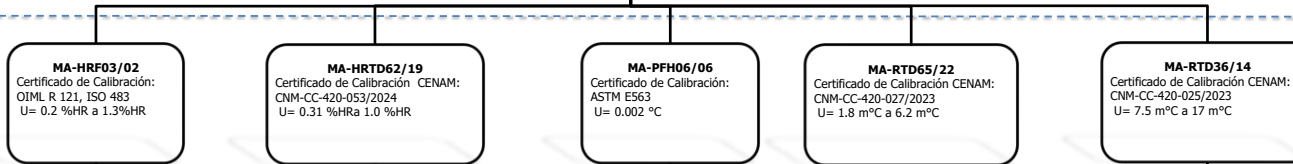

PATRONES DE REFERENCIA METAS
CALIBRADOS POR: CENAM

Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTB-01
Marca: VAISALA
Modelo: HMP77
No. de serie: T3210344
Certificados de Calibración Metas:
2-21895/3.1-21895
Alcance calibrado:
0.001 5 °C a 50.018 °C
Incertidumbre:
U= 0.006 4 °C a 0.019 °C
3.1-21895
Alcance calibrado:
11.31 %HR a 97.57 %HR
Incertidumbre:
U= 0.64 %HR a 0.80 %HR

Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTB-02
Marca: VAISALA
Modelo: HMP77
No. de serie: T3210345
Certificados de Calibración Metas:
2-21896/3.1-21896
Alcance calibrado:
0.0015 °C a 49.983 °C
Incertidumbre:
U= 0.006 4 °C a 0.019 °C
3.1-21896
Alcance calibrado:
11.31 %HR a 97.57 %HR
Incertidumbre:
U= 0.64 %HR a 0.80 %HR

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: METAS

Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTA-01
Marca: VAISALA
Modelo: HMP77
No. de serie: T3210329
Certificados de Calibración MESS:
MESS-CC-TEP-1818/2024
Alcance calibrado:
15.00 °C a 35.10 °C
Incertidumbre:
U= 0.10 °C
Alcance calibrado:
10.27 %HR a 87.37 %HR
Incertidumbre:
U= 1.0 %HR a 2.0 %HR
Vigencia: 2025-11

Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTA-02
Marca: VAISALA
Modelo: HMP77
No. de serie: T3210330
Certificados de Calibración MESS:
MESS-CC-TEP-1819/2024
Alcance calibrado:
15.11 °C a 35.16 °C
Incertidumbre:
U= 0.10 °C
Alcance calibrado:
10.06 %HR a 88.58 %HR
Incertidumbre:
U= 1.0 %HR a 2.0 %HR
Vigencia: 2025-11

Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTA-03
Marca: VAISALA
Modelo: HMP77
No. de serie: T3210331
Certificados de Calibración MESS:
MESS-CC-TEP-1820/2024
Alcance calibrado:
15.11 °C a 35.16 °C
Incertidumbre:
U= 0.10 °C
Alcance calibrado:
10.06 %HR a 88.58 %HR
Incertidumbre:
U= 1.0 %HR a 2.0 %HR
Vigencia: 2025-11

Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTA-04
Marca: VAISALA
Modelo: HMP77
No. de serie: T3210332
Certificados de Calibración MESS:
MESS-CC-TEP-1814/2024
Alcance calibrado:
15.00 °C a 35.10 °C
Incertidumbre:
U= 0.10 °C
Alcance calibrado:
10.27 %HR a 87.37 %HR
Incertidumbre:
U= 1.0 %HR a 2.0 %HR
Vigencia: 2025-11

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: MESS

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Elaboró:

Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Revisó:

Ing. María De La Paz Cruz

Aprobó:

Ing. Adrián De Jesús Castruita Romero



Fecha de revisión: 2024-12-02